

Paciente


FUENTES RAMIREZ PAMELA

Fecha de nacim. 08-03-1969 Sexo Femenino
ID del paciente 12097138-7

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

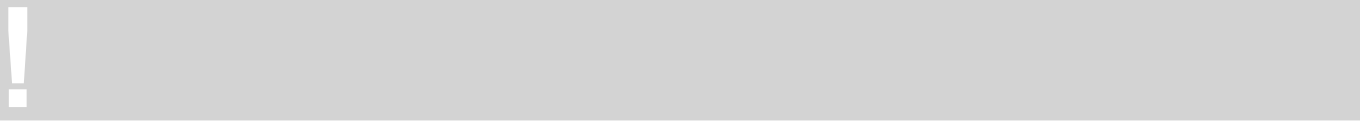

OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 22,28 mm				SD: 8 µm				AL: 22,37 mm				SD: 9 µm			
ACD: 2,38 mm				SD: 5 µm				ACD: 2,40 mm				SD: 9 µm			
LT: 4,82 mm				SD: 9 µm				LT: 4,85 mm				SD: 15 µm			
WTW: 12,3 mm								WTW: 12,2 mm							
SE: 42,93 D				SD: 0,02 D				SE: 43,04 D				SD: 0,01 D			
ΔK: -1,01 D @168°				K1: 42,43 D @168°				ΔK: -1,18 D @172°				K1: 42,46 D @172°			
				K2: 43,44 D @ 78°								K2: 43,64 D @ 82°			
TSE: 43,08 D				SD: 0,02 D				TSE: 43,22 D				SD: 0,02 D			
TK1: 42,62 D @164°								TK1: 42,70 D @173°							
ΔTK: -0,93 D @164°				TK2: 43,55 D @ 74°				ΔTK: -1,05 D @173°				TK2: 43,75 D @ 83°			
K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT				K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217				A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179				A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217				A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+27,50 -0,89				+27,00 -0,80				+27,00 -0,87				+26,50 -0,78			
+27,00 -0,51				+26,50 -0,42				+26,50 -0,50				+26,00 -0,41			
+26,50 -0,15				+26,00 -0,05				+26,00 -0,13				+25,50 -0,04			
+26,00 +0,22				+25,50 +0,31				+25,50 +0,23				+25,00 +0,33			
+25,50 +0,58				+25,00 +0,68				+25,00 +0,59				+24,50 +0,69			
+26,30 Emetropía				+25,93 Emetropía				+25,82 Emetropía				+25,45 Emetropía			
K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293				A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208				A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293				A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+27,50 -0,76				+28,00 -0,88				+27,00 -0,74				+27,50 -0,88			
+27,00 -0,39				+27,50 -0,52				+26,50 -0,37				+27,00 -0,51			
+26,50 -0,03				+27,00 -0,15				+26,00 +0,00				+26,50 -0,15			
+26,00 +0,33				+26,50 +0,21				+25,50 +0,36				+26,00 +0,21			
+25,50 +0,69				+26,00 +0,56				+25,00 +0,71				+25,50 +0,57			
+26,46 Emetropía				+26,79 Emetropía				+25,99 Emetropía				+26,30 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

FUENTES RAMIREZ PAMELA

Fecha de nacim. 08-03-1969 Sexo Femenino
ID del paciente 12097138-7

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 22,28 mm
ACD: 2,38 mm
LT: 4,82 mm
WTW: 12,3 mm
SE: 42,93 D
ΔK: -1,01 D @168°
TSE: 43,08 D
ΔTK: -0,93 D @164°

SD: 8 μm
SD: 5 μm
SD: 9 μm

K1: 42,43 D @168°
K2: 43,44 D @ 78°
TK1: 42,62 D @164°
TK2: 43,55 D @ 74°

AL: 22,37 mm
ACD: 2,40 mm
LT: 4,85 mm
WTW: 12,2 mm
SE: 43,04 D
ΔK: -1,18 D @172°
TSE: 43,22 D
ΔTK: -1,05 D @173°

SD: 9 μm
SD: 9 μm
SD: 15 μm

K1: 42,46 D @172°
K2: 43,64 D @ 82°
TK1: 42,70 D @173°
TK2: 43,75 D @ 83°

K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis -
A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122
IOL (D) Ref (D)
+27,50 -0,65
+27,00 -0,28
+26,50 +0,08
+26,00 +0,44
+25,50 +0,79
+26,61 Emetropía

K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis -
A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100
IOL (D) Ref (D)
+27,00 -0,64
+26,50 -0,27
+26,00 +0,10
+25,50 +0,46
+25,00 +0,82
+26,14 Emetropía

K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis -
A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122
IOL (D) Ref (D)
+27,00 -0,65
+26,50 -0,29
+26,00 +0,08
+25,50 +0,43
+25,00 +0,79
+26,11 Emetropía

K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis -
A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100
IOL (D) Ref (D)
+26,50 -0,63
+26,00 -0,26
+25,50 +0,10
+25,00 +0,47
+24,50 +0,82
+25,64 Emetropía

K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis -
A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211
IOL (D) Ref (D)
+27,50 -0,55
+27,00 -0,19
+26,50 +0,17
+26,00 +0,53
+25,50 +0,88
+26,74 Emetropía

K Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis -
A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205
IOL (D) Ref (D)
+28,00 -0,88
+27,50 -0,51
+27,00 -0,14
+26,50 +0,21
+26,00 +0,57
+26,80 Emetropía

K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis -
A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211
IOL (D) Ref (D)
+27,50 -0,91
+27,00 -0,54
+26,50 -0,18
+26,00 +0,18
+25,50 +0,53
+26,25 Emetropía

K Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis -
A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205
IOL (D) Ref (D)
+27,50 -0,88
+27,00 -0,51
+26,50 -0,15
+26,00 +0,21
+25,50 +0,57
+26,30 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

FUENTES RAMIREZ PAMELA


Fecha de nacim. 08-03-1969
ID del paciente 12097138-7

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

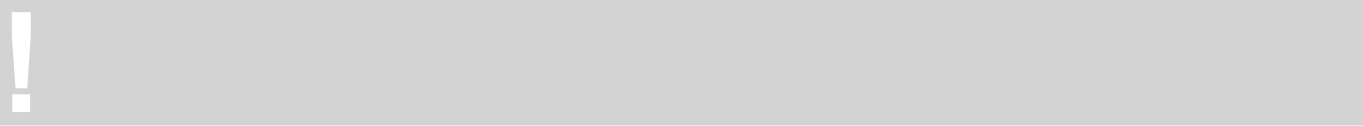

OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: --- LVC: No tratado	
Valores biométricos			
AL: 22,28 mm CCT: 571 µm ACD: 2,38 mm LT: 4,82 mm		SD: 8 µm SD: 4 µm SD: 5 µm SD: 9 µm WTW: 12,3 mm P: 5,6 mm Ix: +0,6 mm Iy: +0,0 mm CW-Chord: 0,5 mm @ 211°	
SE: 42,93 D K1: 42,43 D @ 168° K2: 43,44 D @ 78° ΔK: -1,01 D @ 168°		SD: 0,02 D SD: 0,02 D SD: 0,04 D TSE: 43,08 D TK1: 42,62 D @ 164° TK2: 43,55 D @ 74° ΔTK: -0,93 D @ 164° SD: 0,02 D SD: 0,04 D SD: 0,03 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma
------------	-------



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

FUENTES RAMIREZ PAMELA


Fecha de nacim. 08-03-1969
ID del paciente 12097138-7

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

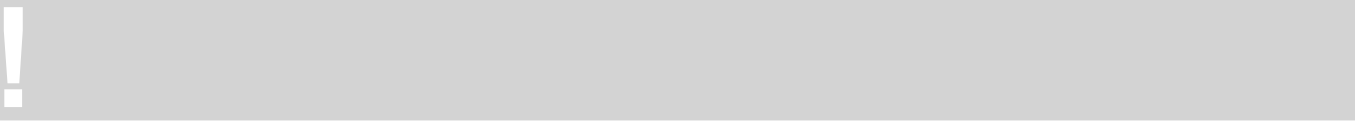

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica

Ref: ---

VS: Humor vítreo

VA: ---

LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 22,37 mm

CCT: 572 µm

ACD: 2,40 mm

LT: 4,85 mm

SD: 9 µm

SD: 4 µm

SD: 9 µm

SD: 15 µm

WTW: 12,2 mm

P: 5,8 mm

Ix: -0,6 mm

Iy: +0,0 mm

CW-Chord: 0,4 mm @ 339°

SE: 43,04 D

K1: 42,46 D @ 172°

K2: 43,64 D @ 82°

ΔK: -1,18 D @ 172°

SD: 0,01 D

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

TSE: 43,22 D

TK1: 42,70 D @ 173°

TK2: 43,75 D @ 83°

ΔTK: -1,05 D @ 173°

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

SD: 0,05 D

Scan B

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved