

Paciente

HERRERA NAVARRETE ROMULO

Fecha de nacim. 24-03-1942 Sexo Masculino
ID del paciente 3950161-9

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.67 mm. - Nota: Ojo corto.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.61 mm. - Nota: Ojo corto.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 21,67 mm
ACD: 2,43 mm
LT: 5,42 mm
WTW: 11,8 mm
SE: 42,68 D
ΔK: -2,25 D @ 114°
TSE: 42,74 D
ΔTK: -2,38 D @ 114°

SD: 9 μm
SD: 6 μm
SD: 7 μm
SD: 0,01 D
SD: 0,00 D

K1: 41,59 D @ 114°
K2: 43,84 D @ 24°
TK1: 41,58 D @ 114°
TK2: 43,97 D @ 24°

AL: 21,61 mm
ACD: 2,19 mm
LT: 5,63 mm
WTW: 12,2 mm
SE: 42,39 D
ΔK: -0,97 D @ 59°
TSE: 42,45 D
ΔTK: -1,10 D @ 62°

SD: 19 μm
SD: 5 μm
SD: 10 μm
SD: 0,04 D
SD: 0,06 D

K1: 41,91 D @ 59°
K2: 42,88 D @ 149°
TK1: 41,91 D @ 62°
TK2: 43,01 D @ 152°

K Alcon SN60WF

- Haigis -
A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217
IOL (D) Ref (D)
+30,00 -0,73
+29,50 -0,36
+29,00 +0,01
+28,50 +0,38
+28,00 +0,74
+29,02 Emetropía

K Alcon SA60AT

- Haigis -
A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179
IOL (D) Ref (D)
+29,50 -0,63
+29,00 -0,25
+28,50 +0,12
+28,00 +0,49
+27,50 +0,86
+28,67 Emetropía

K Alcon SN60WF

- Haigis -
A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217
IOL (D) Ref (D)
+30,00 -0,39
+29,50 -0,01
+29,00 +0,36
+28,50 +0,72
+29,48 Emetropía

K Alcon SA60AT

- Haigis -
A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179
IOL (D) Ref (D)
+30,00 -0,66
+29,50 -0,28
+29,00 +0,09
+28,50 +0,46
+28,00 +0,83
+29,12 Emetropía

K JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis -
A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293
IOL (D) Ref (D)
+30,00 -0,70
+29,50 -0,32
+29,00 +0,05
+28,50 +0,41
+28,00 +0,77
+29,07 Emetropía

K Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis -
A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208
IOL (D) Ref (D)
+30,50 -0,68
+30,00 -0,31
+29,50 +0,05
+29,00 +0,42
+28,50 +0,77
+29,58 Emetropía

K JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis -
A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293
IOL (D) Ref (D)
+30,50 -0,73
+30,00 -0,35
+29,50 +0,02
+29,00 +0,39
+28,50 +0,75
+29,53 Emetropía

K Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis -
A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208
IOL (D) Ref (D)
+31,00 -0,69
+30,50 -0,32
+30,00 +0,05
+29,50 +0,41
+29,00 +0,77
+30,06 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

HERRERA NAVARRETE ROMULO

Fecha de nacim. 24-03-1942 Sexo Masculino
ID del paciente 3950161-9

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.67 mm. - Nota: Ojo corto.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.61 mm. - Nota: Ojo corto.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

Estatus del ojo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 21,67 mm

ACD: 2,43 mm

LT: 5,42 mm

WTW: 11,8 mm

SE: 42,68 D

ΔK: -2,25 D @ 114°

TSE: 42,74 D

ΔTK: -2,38 D @ 114°

SD: 9 μm

SD: 6 μm

SD: 7 μm

SD: 0,01 D

SD: 0,00 D

SD: 0,00 D

K1: 41,59 D @ 114°

K2: 43,84 D @ 24°

TK1: 41,58 D @ 114°

TK2: 43,97 D @ 24°

AL: 21,61 mm

ACD: 2,19 mm

LT: 5,63 mm

WTW: 12,2 mm

SE: 42,39 D

ΔK: -0,97 D @ 59°

TSE: 42,45 D

ΔTK: -1,10 D @ 62°

SD: 19 μm

SD: 5 μm

SD: 10 μm

SD: 0,04 D

SD: 0,06 D

SD: 0,06 D

K1: 41,91 D @ 59°

K2: 42,88 D @ 149°

TK1: 41,91 D @ 62°

TK2: 43,01 D @ 152°

K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis -

A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122

IOL (D) Ref (D)

+30,00 -0,34

+29,50 +0,02

+29,00 +0,38

+28,50 +0,74

+29,53 Emetropía

K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis -

A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100

IOL (D) Ref (D)

+30,00 -0,71

+29,50 -0,33

+29,00 +0,04

+28,50 +0,40

+28,00 +0,76

+29,05 Emetropía

K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis -

A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122

IOL (D) Ref (D)

+30,00 -0,34

+29,50 +0,01

+29,00 +0,38

+29,00 +0,74

+30,02 Emetropía

K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis -

A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100

IOL (D) Ref (D)

+31,00 -1,19

+30,00 -0,43

+29,50 -0,05

+29,00 +0,32

+28,50 +0,68

+29,43 Emetropía

K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis -

A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211

IOL (D) Ref (D)

+30,50 -0,72

+30,00 -0,35

+29,50 +0,01

+29,00 +0,37

+28,50 +0,73

+29,52 Emetropía

K Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis -

A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205

IOL (D) Ref (D)

+30,00 -0,32

+29,00 +0,41

+28,50 +0,77

+29,57 Emetropía

K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis -

A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211

IOL (D) Ref (D)

+31,00 -0,74

+30,50 -0,36

+30,00 +0,00

+29,50 +0,37

+29,00 +0,73

+30,01 Emetropía

K Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis -

A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205

IOL (D) Ref (D)

+29,50 +0,50

+29,00 +0,86

+30,19 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

HERRERA NAVARRETE ROMULO

Fecha de nacim. 24-03-1942
ID del paciente 3950161-9

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.67 mm. - Nota: Ojo corto.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 21,67 mm SD: 9 µm WTW: 11,8 mm lx: +0,5 mm ly: +0,3 mm
CCT: 610 µm SD: 4 µm P: 2,9 mm CW-Chord: 0,5 mm @ 218°
ACD: 2,43 mm SD: 6 µm
LT: 5,42 mm SD: 7 µm

SE: 42,68 D	SD: 0,01 D	TSE: 42,74 D	SD: 0,00 D
K1: 41,59 D @ 114°	SD: 0,02 D	TK1: 41,58 D @ 114°	SD: 0,04 D
K2: 43,84 D @ 24°	SD: 0,03 D	TK2: 43,97 D @ 24°	SD: 0,05 D
ΔK: -2,25 D @ 114°		ΔTK: -2,38 D @ 114°	


Scan B

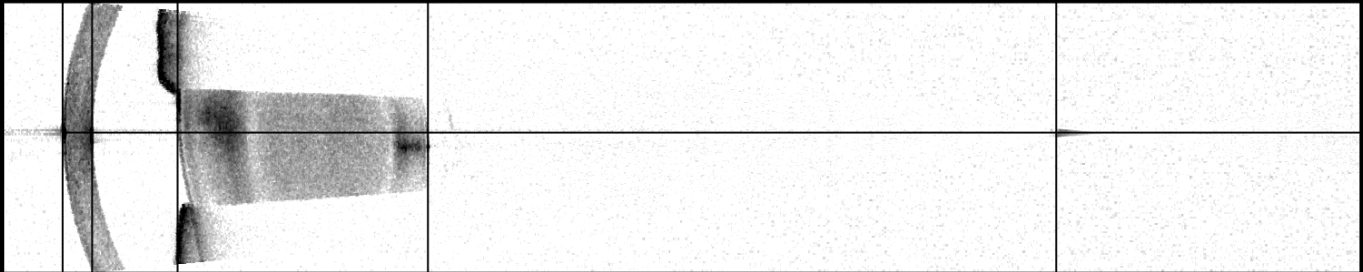

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

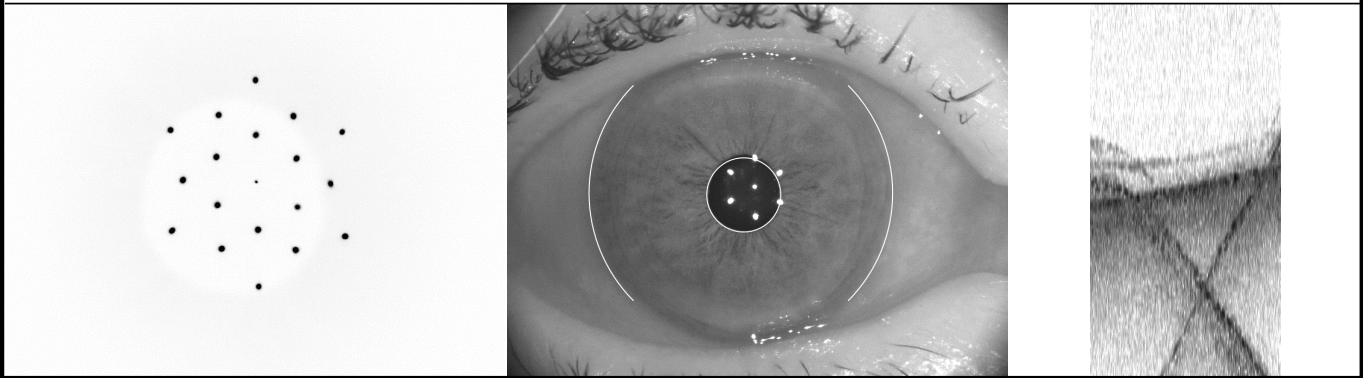

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

HERRERA NAVARRETE ROMULO

Fecha de nacim. 24-03-1942
ID del paciente 3950161-9

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.61 mm. - Nota: Ojo corto.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 21,61 mm SD: 19 µm WTW: 12,2 mm lx: +0,0 mm ly: -0,2 mm
CCT: 615 µm SD: 5 µm P: 3,1 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 186°
ACD: 2,19 mm SD: 5 µm
LT: 5,63 mm SD: 10 µm

SE: 42,39 D	SD: 0,04 D	TSE: 42,45 D	SD: 0,06 D
K1: 41,91 D @ 59°	SD: 0,04 D	TK1: 41,91 D @ 62°	SD: 0,06 D
K2: 42,88 D @ 149°	SD: 0,05 D	TK2: 43,01 D @ 152°	SD: 0,07 D
ΔK: -0,97 D @ 59°		ΔTK: -1,10 D @ 62°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

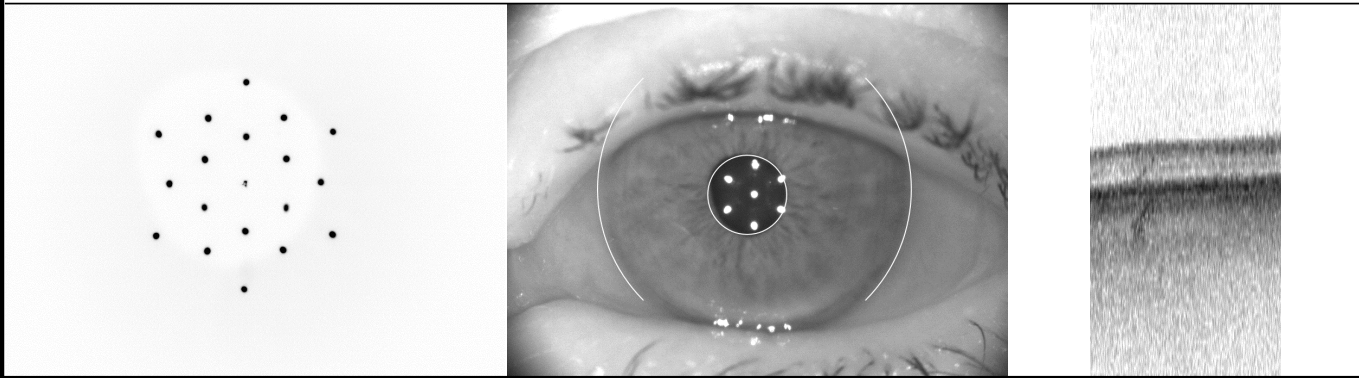

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

