

Paciente

HERRERA NAVARRETE ROMULO

Fecha de nacim. 24-03-1942 Sexo Masculino
ID del paciente 3950161-9

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.67 mm. - Nota: Ojo corto.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.61 mm. - Nota: Ojo corto.

OD derecho				Cálculo de IOL				OS izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°				LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 21,67 mm ACD: 2,43 mm LT: 5,42 mm WTW: 11,8 mm				SD: 9 µm SD: 6 µm SD: 7 µm				AL: 21,61 mm ACD: 2,19 mm LT: 5,63 mm WTW: 12,2 mm				SD: 19 µm SD: 5 µm SD: 10 µm			
SE: 42,68 D ΔK: -2,25 D @114° TSE: 42,74 D ΔTK: -2,38 D @114°				SD: 0,01 D K1: 41,59 D @ 114° K2: 43,84 D @ 24° TK1: 41,58 D @ 114° TK2: 43,97 D @ 24°				SE: 42,39 D ΔK: -0,97 D @ 59° TSE: 42,45 D ΔTK: -1,10 D @ 62°				SD: 0,04 D K1: 41,91 D @ 59° K2: 42,88 D @ 149° TK1: 41,91 D @ 62° TK2: 43,01 D @ 152°			
K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT				K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT			
- Barrett Universal II - LF: +1,88 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) --- --- +30,00 -0,47 +29,50 -0,09 +29,00 +0,28 +28,50 +0,64 +29,38 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +1,64 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) +29,50 -0,59 +29,00 -0,21 +28,50 +0,17 +28,00 +0,54 +27,50 +0,91 +28,73 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +1,88 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) --- --- +30,00 +0,03 +29,50 +0,40 +29,00 +0,77 +30,04 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +1,64 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) +30,50 -0,86 +30,00 -0,48 +29,50 -0,09 +29,00 +0,28 +28,50 +0,66 +29,38 Emetropía			
K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)			
- Barrett Universal II - LF: +2,02 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +31,00 -0,92 +30,50 -0,55 +30,00 -0,17 +29,50 +0,19 +29,00 +0,56 +29,76 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +2,02 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) +31,00 -0,92 +30,50 -0,55 +30,00 -0,17 +29,50 +0,19 +29,00 +0,56 +29,76 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +2,02 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +31,50 -0,80 +31,00 -0,42 +30,50 -0,05 +30,00 +0,32 +29,50 +0,68 +30,44 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +2,02 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) +31,50 -0,80 +31,00 -0,42 +30,50 -0,05 +30,00 +0,32 +29,50 +0,68 +30,44 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

HERRERA NAVARRETE ROMULO

Fecha de nacim. 24-03-1942 Sexo Masculino
ID del paciente 3950161-9

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.67 mm. - Nota: Ojo corto.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.61 mm. - Nota: Ojo corto.

OD derecho				Cálculo de IOL				OS izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°				LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 21,67 mm ACD: 2,43 mm LT: 5,42 mm WTW: 11,8 mm				SD: 9 µm SD: 6 µm SD: 7 µm				AL: 21,61 mm ACD: 2,19 mm LT: 5,63 mm WTW: 12,2 mm				SD: 19 µm SD: 5 µm SD: 10 µm			
SE: 42,68 D ΔK: -2,25 D @114° TSE: 42,74 D ΔTK: -2,38 D @114°				SD: 0,01 D K1: 41,59 D @114° K2: 43,84 D @ 24° TK1: 41,58 D @114° TK2: 43,97 D @ 24°				SE: 42,39 D ΔK: -0,97 D @ 59° TSE: 42,45 D ΔTK: -1,10 D @ 62°				SD: 0,04 D K1: 41,91 D @ 59° K2: 42,88 D @149° TK1: 41,91 D @ 62° TK2: 43,01 D @152°			
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0			
- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar				- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar				- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar				- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
--- ---				+31,00 -1,10				--- ---				+32,00 -1,36			
+30,00 -0,24				+30,00 -0,34				--- ---				+31,00 -0,60			
+29,50 +0,13				+29,50 +0,03				--- ---				+30,00 +0,15			
+29,00 +0,50				+29,00 +0,40				+30,00 +0,25				+29,50 +0,52			
+28,50 +0,86				+28,50 +0,76				+29,50 +0,62				+29,00 +0,88			
+29,68 Emetropía				+29,54 Emetropía				+30,34 Emetropía				+30,21 Emetropía			
K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)			
- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar				- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar				- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar				- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
--- ---				+30,50 -0,72				--- ---				+31,00 -0,60			
+30,00 -0,24				+30,00 -0,34				--- ---				+30,50 -0,22			
+29,50 +0,13				+29,50 +0,03				--- ---				+30,00 +0,15			
+29,00 +0,50				+29,00 +0,40				+30,00 +0,26				+29,50 +0,52			
+28,50 +0,86				+28,50 +0,76				+29,50 +0,62				+29,00 +0,88			
+29,69 Emetropía				+29,54 Emetropía				+30,35 Emetropía				+30,21 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

HERRERA NAVARRETE ROMULO

Fecha de nacim. 24-03-1942
ID del paciente 3950161-9

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.67 mm. - Nota: Ojo corto.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 21,67 mm	SD: 9 µm	WTW: 11,8 mm	Ix: +0,5 mm	Iy: +0,3 mm
CCT: 610 µm	SD: 4 µm	P: 2,9 mm	CW-Chord: 0,5 mm @ 218°	
ACD: 2,43 mm	SD: 6 µm			
LT: 5,42 mm	SD: 7 µm			

SE: 42,68 D	SD: 0,01 D	TSE: 42,74 D	SD: 0,00 D
K1: 41,59 D @ 114°	SD: 0,02 D	TK1: 41,58 D @ 114°	SD: 0,04 D
K2: 43,84 D @ 24°	SD: 0,03 D	TK2: 43,97 D @ 24°	SD: 0,05 D
ΔK: -2,25 D @ 114°		ΔTK: -2,38 D @ 114°	


Scan B

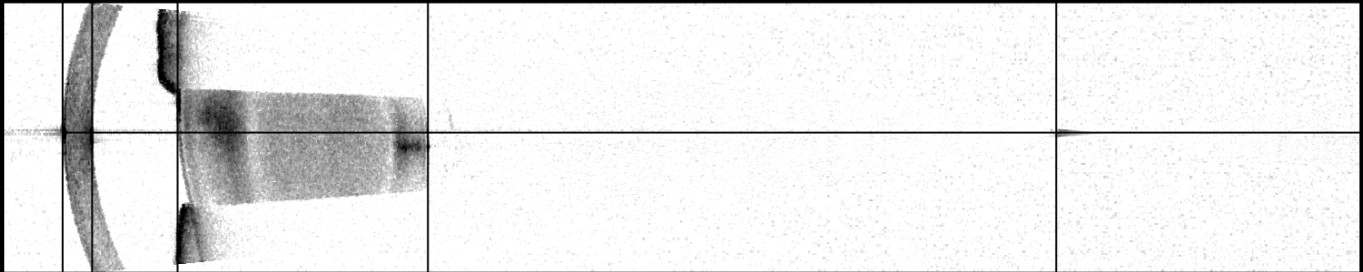

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

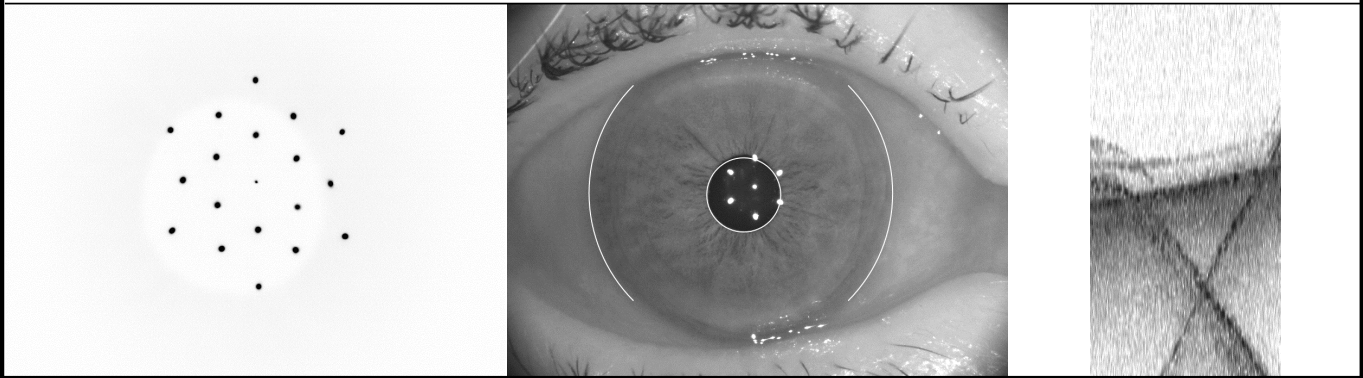

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

HERRERA NAVARRETE ROMULO

Fecha de nacim. 24-03-1942
ID del paciente 3950161-9

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.61 mm. - Nota: Ojo corto.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 21,61 mm SD: 19 µm WTW: 12,2 mm lx: +0,0 mm ly: -0,2 mm
CCT: 615 µm SD: 5 µm P: 3,1 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 186°
ACD: 2,19 mm SD: 5 µm
LT: 5,63 mm SD: 10 µm

SE: 42,39 D	SD: 0,04 D	TSE: 42,45 D	SD: 0,06 D
K1: 41,91 D @ 59°	SD: 0,04 D	TK1: 41,91 D @ 62°	SD: 0,06 D
K2: 42,88 D @ 149°	SD: 0,05 D	TK2: 43,01 D @ 152°	SD: 0,07 D
ΔK: -0,97 D @ 59°		ΔTK: -1,10 D @ 62°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

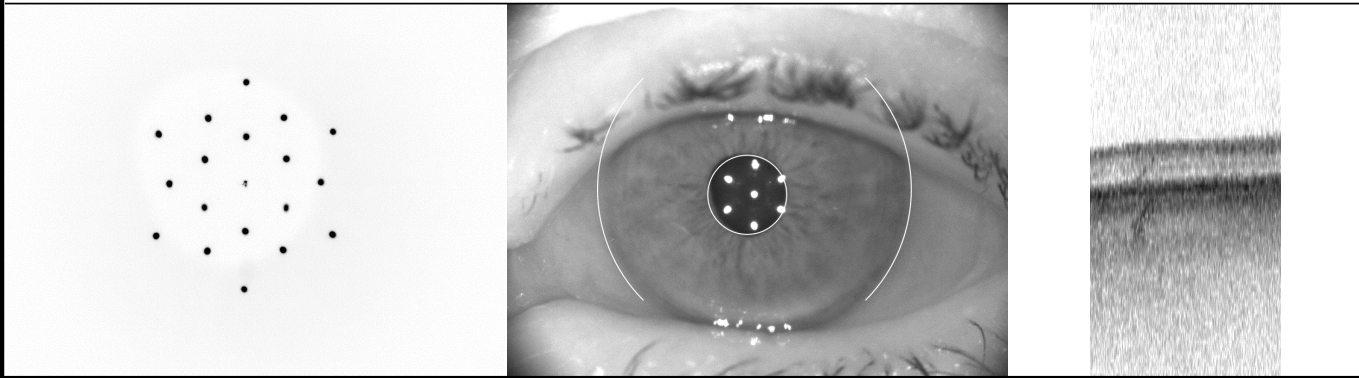

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

