

Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941 Sexo Femenino
ID del paciente 4666756-5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

Estatus del ojo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 27,81 mm (!)

ACD: 3,25 mm

LT: 5,16 mm

WTW: 11,4 mm

SD: 25 μm

SD: 7 μm

SD: 10 μm

SE: 44,09 D

ΔK: -3,85 D @ 114°

TSE: 44,10 D

ΔTK: -4,12 D @ 113°

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

K1: 42,25 D @ 114°

K2: 46,10 D @ 24°

TK1: 42,13 D @ 113°

TK2: 46,25 D @ 23°

AL: 24,78 mm

ACD: 2,94 mm

LT: 5,22 mm

WTW: 11,5 mm

SD: 11 μm

SD: 5 μm

SD: 17 μm

SE: 43,75 D

ΔK: -1,74 D @ 72°

TSE: 43,79 D

ΔTK: -1,90 D @ 74°

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

K1: 42,89 D @ 72°

K2: 44,64 D @ 162°

TK1: 42,86 D @ 74°

TK2: 44,76 D @ 164°

K

Alcon SN60WF

- Holladay 2 -

ACD: +5,601

IOL (D) Ref (D)

+8,00 -0,56

+7,50 -0,26

+7,00 +0,04

+6,50 +0,33

+6,00 +0,62

+7,06 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Holladay 2 -

ACD: +5,426

IOL (D) Ref (D)

+8,00 -0,66

+7,50 -0,35

+7,00 -0,05

+6,50 +0,25

+6,00 +0,55

+6,92 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Holladay 2 -

ACD: +5,601

IOL (D) Ref (D)

+18,00 -0,72

+17,50 -0,39

+17,00 -0,07

+16,50 +0,25

+16,00 +0,57

+16,90 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Holladay 2 -

ACD: +5,426

IOL (D) Ref (D)

+17,50 -0,60

+17,00 -0,26

+16,50 +0,07

+16,00 +0,39

+15,50 +0,71

+16,60 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Holladay 2 -

ACD: +5,745

IOL (D) Ref (D)

+8,00 -0,48

+7,50 -0,19

+7,00 +0,10

+6,50 +0,39

+6,00 +0,68

+7,18 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Holladay 2 -

ACD: +5,663

IOL (D) Ref (D)

+8,00 -0,53

+7,50 -0,23

+7,00 +0,06

+6,50 +0,36

+6,00 +0,64

+7,11 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Holladay 2 -

ACD: +5,745

IOL (D) Ref (D)

+18,00 -0,55

+17,50 -0,23

+17,00 +0,09

+16,50 +0,41

+16,00 +0,72

+17,14 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Holladay 2 -

ACD: +5,663

IOL (D) Ref (D)

+18,00 -0,65

+17,50 -0,32

+17,00 +0,00

+16,50 +0,32

+16,00 +0,64

+17,00 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941 Sexo Femenino
ID del paciente 4666756-5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 27,81 mm (!)
ACD: 3,25 mm
LT: 5,16 mm
WTW: 11,4 mm

SD: 25 μm
SD: 7 μm
SD: 10 μm

SE: 44,09 D
ΔK: -3,85 D @ 114°
TSE: 44,10 D
ΔTK: -4,12 D @ 113°

SD: 0,02 D
K1: 42,25 D @ 114°
SD: 0,02 D
TK1: 42,13 D @ 113°
SD: 0,02 D
TK2: 46,25 D @ 23°

AL: 24,78 mm
ACD: 2,94 mm
LT: 5,22 mm
WTW: 11,5 mm

SD: 11 μm
SD: 5 μm
SD: 17 μm

SE: 43,75 D
ΔK: -1,74 D @ 72°
TSE: 43,79 D
ΔTK: -1,90 D @ 74°

SD: 0,02 D
K1: 42,89 D @ 72°
SD: 0,02 D
K2: 44,64 D @ 162°
SD: 0,02 D
TK1: 42,86 D @ 74°
SD: 0,02 D
TK2: 44,76 D @ 164°

KALCON CLAREON TORIC CN
W0TX (2-9)
- Holladay 2 -
ACD: +5,610

IOL (D)Ref (D)
+8,00-0,56
+7,50-0,26
+7,00+0,04
+6,50+0,33
+6,00+0,62
+7,07Emetropía

KJNJ ICB00 EYHANCE
- Holladay 2 -
ACD: +5,724

IOL (D)Ref (D)
+8,00-0,50
+7,50-0,20
+7,00+0,09
+6,50+0,38
+6,00+0,67
+7,16Emetropía

KALCON CLAREON TORIC CN
W0TX (2-9)
- Holladay 2 -
ACD: +5,610

IOL (D)Ref (D)
+18,00-0,71
+17,50-0,38
+17,00-0,06
+16,50+0,26
+16,00+0,58
+16,91Emetropía

KJNJ ICB00 EYHANCE
- Holladay 2 -
ACD: +5,724

IOL (D)Ref (D)
+18,00-0,58
+17,50-0,25
+17,00+0,07
+16,50+0,39
+16,00+0,70
+17,11Emetropía

KAlcon MN60MA (+diopeters)
- Holladay 2 -
ACD: +14,309

IOL (D)Ref (D)

+27,73Emetropía

KAlcon MN60MA (-diopeters)
- Holladay 2 -
ACD: -3,591

IOL (D)Ref (D)

+3,05Emetropía

KAlcon MN60MA (+diopeters)
- Holladay 2 -
ACD: +14,309

IOL (D)Ref (D)

+54,57Emetropía

KAlcon MN60MA (-diopeters)
- Holladay 2 -
ACD: -3,591

IOL (D)Ref (D)

+7,89Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

La longitud axial del ojo derecho es 3.04 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OD: Longitud axial del ojo derecho 27.81 mm. - Nota: Ojo largo. OD: Cilindro del ojo derecho -3.85 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 27,81 mm (!) SD: 25 µm WTW: 11,4 mm lx: +0,4 mm ly: +0,2 mm
CCT: 615 µm SD: 4 µm P: 2,4 mm CW-Chord: 0,1 mm @ 178°
ACD: 3,25 mm SD: 7 µm
LT: 5,16 mm SD: 10 µm

SE: 44,09 D	SD: 0,02 D	TSE: 44,10 D	SD: 0,02 D
K1: 42,25 D @ 114°	SD: 0,04 D	TK1: 42,13 D @ 113°	SD: 0,04 D
K2: 46,10 D @ 24°	SD: 0,02 D	TK2: 46,25 D @ 23°	SD: 0,01 D
ΔK: -3,85 D @ 114°		ΔTK: -4,12 D @ 113°	


Scan B

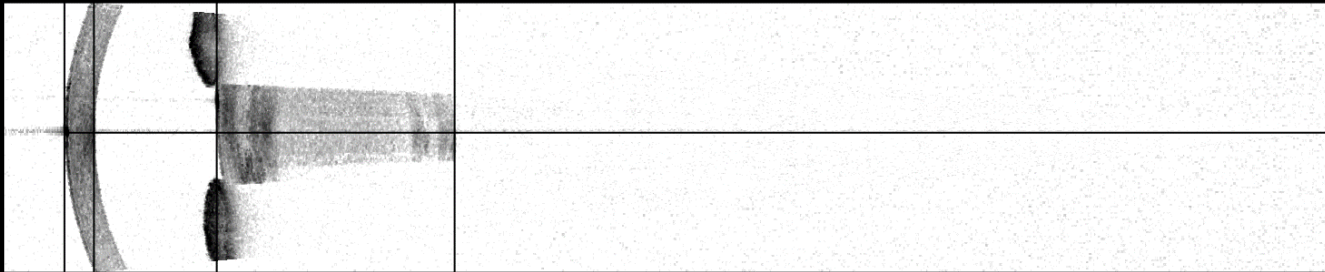

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

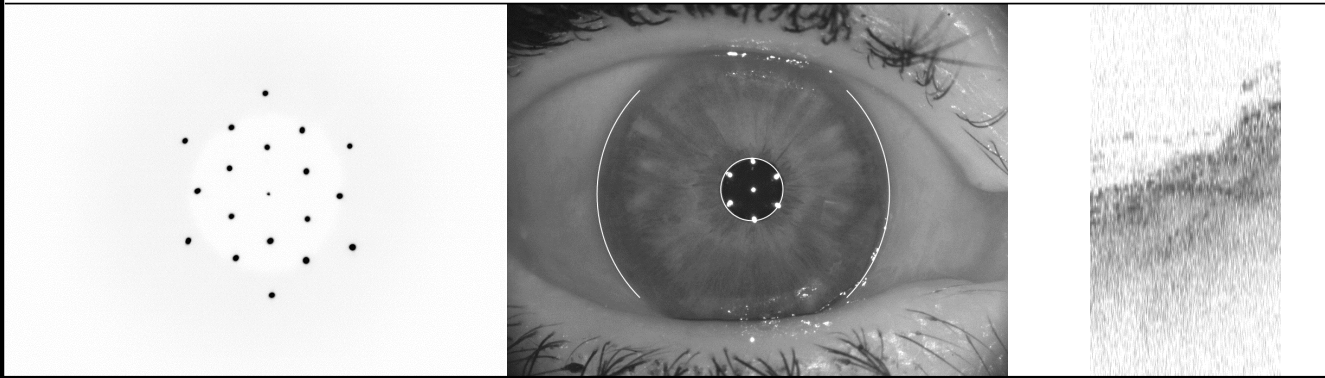

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

La longitud axial del ojo derecho es 3.04 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: ¡Verificación de la fijación! Las longitudes axiales muestran una ligera inconsistencia. ¿Fijación irregular?

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 24,78 mm	SD: 11 µm	WTW: 11,5 mm	Ix: -0,6 mm	Iy: +0,0 mm
CCT: 612 µm	SD: 3 µm	P: 2,9 mm	CW-Chord: 0,1 mm @ 28°	
ACD: 2,94 mm	SD: 5 µm			
LT: 5,22 mm	SD: 17 µm			

SE: 43,75 D	SD: 0,02 D	TSE: 43,79 D	SD: 0,02 D
K1: 42,89 D @ 72°	SD: 0,05 D	TK1: 42,86 D @ 74°	SD: 0,03 D
K2: 44,64 D @ 162°	SD: 0,03 D	TK2: 44,76 D @ 164°	SD: 0,04 D
ΔK: -1,74 D @ 72°		ΔTK: -1,90 D @ 74°	


Scan B

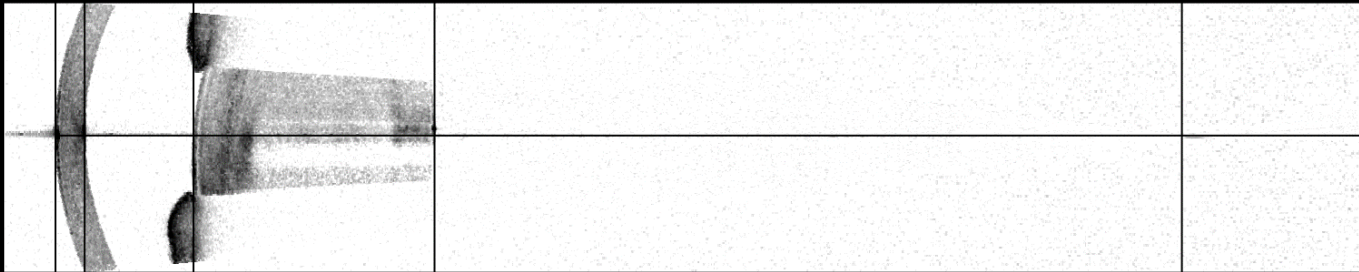

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

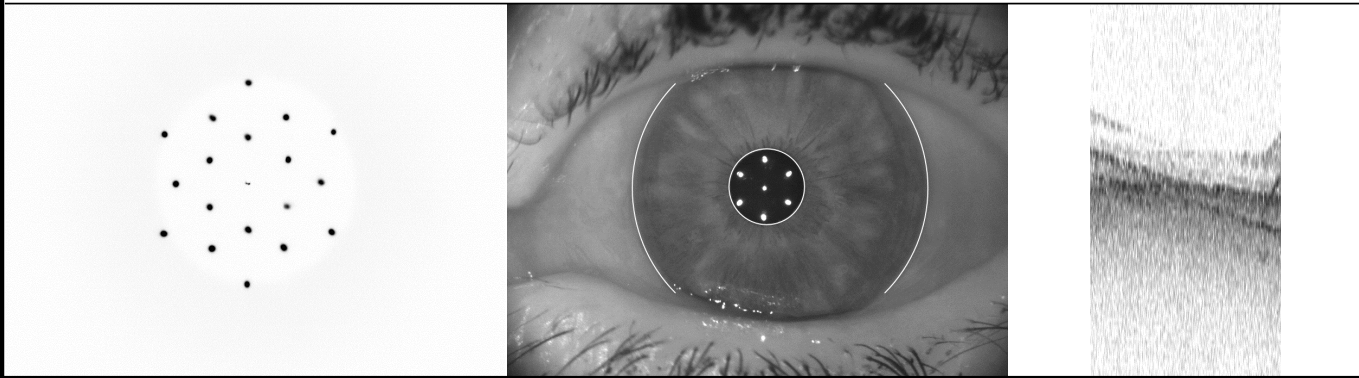

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

Médico Surgeon

Operador

Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Advertencias relativas a mediciones

La longitud axial del ojo derecho es 3.04 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 27.81 mm. - Nota: Ojo largo.

OD: Cilindro del ojo derecho -3.85 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

[OS]

OS: ¡Verificación de la fijación! Las longitudes axiales muestran una ligera inconsistencia. ¿Fijación irregular?

Firma

