

Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941 Sexo Femenino
ID del paciente 4666756-5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 27,81 mm (!)
ACD: 3,25 mm
LT: 5,16 mm
WTW: 11,4 mm

SD: 25 µm
SD: 7 µm
SD: 10 µm

SE: 44,09 D
ΔK: -3,85 D @ 114°
TSE: 44,10 D
ΔTK: -4,12 D @ 113°

SD: 0,02 D
K1: 42,25 D @ 114°
SD: 0,02 D
TK1: 42,13 D @ 113°
K2: 46,10 D @ 24°
TK2: 46,25 D @ 23°

AL: 24,78 mm
ACD: 2,94 mm
LT: 5,22 mm
WTW: 11,5 mm

SD: 11 µm
SD: 5 µm
SD: 17 µm

SE: 43,75 D
ΔK: -1,74 D @ 72°
TSE: 43,79 D
ΔTK: -1,90 D @ 74°

SD: 0,02 D
K1: 42,89 D @ 72°
SD: 0,02 D
TK1: 42,86 D @ 74°
K2: 44,64 D @ 162°
TK2: 44,76 D @ 164°

K

Alcon SN60WF

- Haigis -
A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217
IOL (D) Ref (D)
+8,50 -0,65
+8,00 -0,32
+7,50 +0,00
+7,00 +0,32
+6,50 +0,64
+7,50 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Haigis -
A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179
IOL (D) Ref (D)
+8,50 -0,82
+8,00 -0,48
+7,50 -0,15
+7,00 +0,19
+6,50 +0,52
+7,28 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Haigis -
A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217
IOL (D) Ref (D)
+18,00 -0,84
+17,50 -0,49
+17,00 -0,14
+16,50 +0,20
+16,00 +0,54
+16,79 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Haigis -
A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179
IOL (D) Ref (D)
+17,50 -0,76
+17,00 -0,40
+16,50 -0,05
+16,00 +0,30
+15,50 +0,65
+16,44 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis -
A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293
IOL (D) Ref (D)
+9,00 -0,75
+8,50 -0,43
+8,00 -0,11
+7,50 +0,20
+7,00 +0,51
+7,82 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis -
A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208
IOL (D) Ref (D)
+8,50 -0,59
+8,00 -0,27
+7,50 +0,06
+7,00 +0,37
+6,50 +0,69
+7,59 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis -
A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293
IOL (D) Ref (D)
+18,00 -0,56
+17,50 -0,22
+17,00 +0,12
+16,50 +0,45
+16,00 +0,78
+17,17 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis -
A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208
IOL (D) Ref (D)
+18,00 -0,66
+17,50 -0,32
+17,00 +0,03
+16,50 +0,36
+16,00 +0,70
+17,04 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941 Sexo Femenino
ID del paciente 4666756-5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 27,81 mm (!)

ACD: 3,25 mm

LT: 5,16 mm

WTW: 11,4 mm

SE: 44,09 D

ΔK: -3,85 D @ 114°

TSE: 44,10 D

ΔTK: -4,12 D @ 113°

SD: 25 μm

SD: 7 μm

SD: 10 μm

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

K1: 42,25 D @ 114°

K2: 46,10 D @ 24°

TK1: 42,13 D @ 113°

TK2: 46,25 D @ 23°

AL: 24,78 mm

ACD: 2,94 mm

LT: 5,22 mm

WTW: 11,5 mm

SE: 43,75 D

ΔK: -1,74 D @ 72°

TSE: 43,79 D

ΔTK: -1,90 D @ 74°

SD: 11 μm

SD: 5 μm

SD: 17 μm

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

K1: 42,89 D @ 72°

K2: 44,64 D @ 162°

TK1: 42,86 D @ 74°

TK2: 44,76 D @ 164°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis -

A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122

IOL (D) Ref (D)

+7,25 Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis -

A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100

IOL (D) Ref (D)

+7,15 Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis -

A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122

IOL (D) Ref (D)

+16,62 Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis -

A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100

IOL (D) Ref (D)

+16,40 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis -

A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211

IOL (D) Ref (D)

+7,58 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis -

A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205

IOL (D) Ref (D)

+7,46 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis -

A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211

IOL (D) Ref (D)

+17,02 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis -

A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205

IOL (D) Ref (D)

+16,86 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

La longitud axial del ojo derecho es 3.04 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OD: Longitud axial del ojo derecho 27.81 mm. - Nota: Ojo largo. OD: Cilindro del ojo derecho -3.85 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 27,81 mm (!) SD: 25 µm WTW: 11,4 mm lx: +0,4 mm ly: +0,2 mm
CCT: 615 µm SD: 4 µm P: 2,4 mm CW-Chord: 0,1 mm @ 178°
ACD: 3,25 mm SD: 7 µm
LT: 5,16 mm SD: 10 µm

SE: 44,09 D	SD: 0,02 D	TSE: 44,10 D	SD: 0,02 D
K1: 42,25 D @ 114°	SD: 0,04 D	TK1: 42,13 D @ 113°	SD: 0,04 D
K2: 46,10 D @ 24°	SD: 0,02 D	TK2: 46,25 D @ 23°	SD: 0,01 D
ΔK: -3,85 D @ 114°		ΔTK: -4,12 D @ 113°	


Scan B

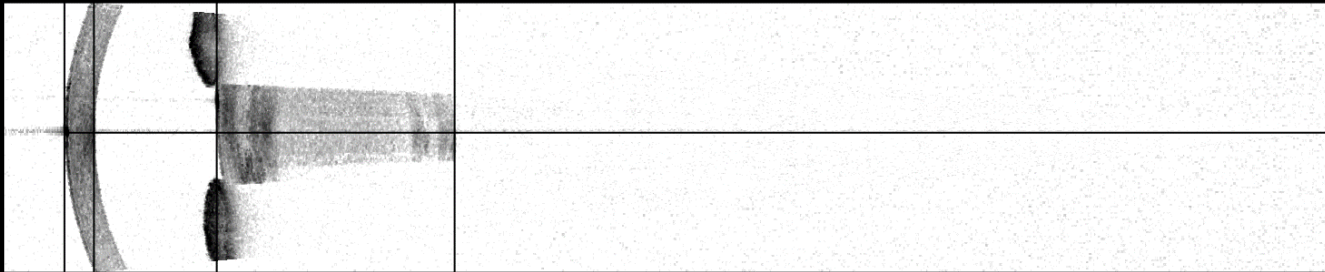

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

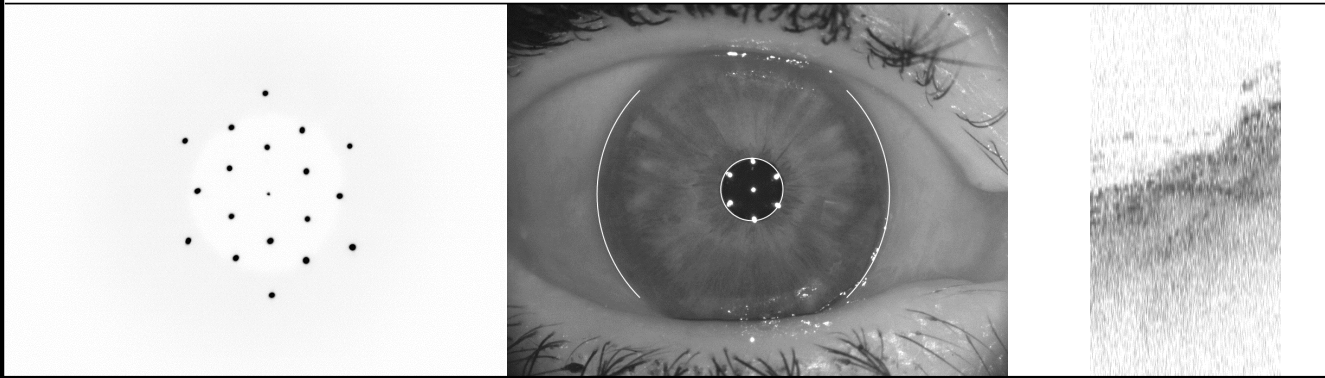

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

La longitud axial del ojo derecho es 3.04 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: ¡Verificación de la fijación! Las longitudes axiales muestran una ligera inconsistencia. ¿Fijación irregular?

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 24,78 mm SD: 11 µm WTW: 11,5 mm lx: -0,6 mm ly: +0,0 mm
CCT: 612 µm SD: 3 µm P: 2,9 mm CW-Chord: 0,1 mm @ 28°
ACD: 2,94 mm SD: 5 µm
LT: 5,22 mm SD: 17 µm

SE: 43,75 D	SD: 0,02 D	TSE: 43,79 D	SD: 0,02 D
K1: 42,89 D @ 72°	SD: 0,05 D	TK1: 42,86 D @ 74°	SD: 0,03 D
K2: 44,64 D @ 162°	SD: 0,03 D	TK2: 44,76 D @ 164°	SD: 0,04 D
ΔK: -1,74 D @ 72°		ΔTK: -1,90 D @ 74°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Advertencias relativas a mediciones

La longitud axial del ojo derecho es 3.04 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 27.81 mm. - Nota: Ojo largo.

OD: Cilindro del ojo derecho -3.85 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

[OS]

OS: ¡Verificación de la fijación! Las longitudes axiales muestran una ligera inconsistencia. ¿Fijación irregular?

Firma

