

Paciente

ROHART BROWN MARIA ANGELICA

Fecha de nacim. 21-11-1945 Sexo Femenino
ID del paciente 5313507-2

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 23,61 mm

SD: 9 µm

ACD: 3,21 mm

SD: 6 µm

LT: 4,35 mm

SD: 9 µm

WTW: 11,9 mm

SE: 43,79 D

SD: 0,01 D

ΔK: -0,49 D @ 145°

TSE: 43,87 D

SD: 0,01 D

ΔTK: -0,59 D @ 132°

K1: 43,55 D @ 145°

K2: 44,04 D @ 55°

TK1: 43,58 D @ 132°

TK2: 44,17 D @ 42°

AL: 23,74 mm

SD: 13 µm

ACD: 3,25 mm

SD: 8 µm

LT: 4,30 mm

SD: 13 µm

WTW: 11,8 mm

SE: 43,66 D

SD: 0,01 D

ΔK: -0,50 D @ 34°

TSE: 43,68 D

SD: 0,00 D

ΔTK: -0,62 D @ 54°

K1: 43,41 D @ 34°

K2: 43,92 D @ 124°

TK1: 43,37 D @ 54°

TK2: 44,00 D @ 144°

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)Ref (D)

+21,50-0,60

+21,00-0,25

+20,50+0,08

+20,00+0,42

+19,50+0,74

+20,62Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)Ref (D)

+21,50-0,77

+21,00-0,42

+20,50-0,08

+20,00+0,26

+19,50+0,59

+20,38Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)Ref (D)

+21,50-0,77

+21,00-0,43

+20,50-0,09

+20,00+0,24

+19,50+0,58

+20,37Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)Ref (D)

+21,00-0,60

+20,50-0,25

+20,00+0,09

+19,50+0,42

+19,00+0,76

+20,13Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)Ref (D)

+22,00-0,76

+21,50-0,42

+21,00-0,09

+20,50+0,24

+20,00+0,57

+20,87Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)Ref (D)

+22,00-0,83

+21,50-0,48

+21,00-0,15

+20,50+0,19

+20,00+0,52

+20,78Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)Ref (D)

+21,50-0,60

+21,00-0,26

+20,50+0,07

+20,00+0,40

+19,50+0,73

+20,61Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)Ref (D)

+21,50-0,66

+21,00-0,32

+20,50+0,01

+20,00+0,35

+19,50+0,67

+20,52Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 12:05 por Administrator. Página 1 de 4

Paciente

ROHART BROWN MARIA ANGELICA

Fecha de nacim. 21-11-1945 Sexo Femenino
ID del paciente 5313507-2

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 23,61 mm

SD: 9 μm

ACD: 3,21 mm

SD: 6 μm

LT: 4,35 mm

SD: 9 μm

WTW: 11,9 mm

SE: 43,79 D

SD: 0,01 D

ΔK: -0,49 D @ 145°

TSE: 43,87 D

SD: 0,01 D

ΔTK: -0,59 D @ 132°

K1: 43,55 D @ 145°

K2: 44,04 D @ 55°

TK1: 43,58 D @ 132°

TK2: 44,17 D @ 42°

AL: 23,74 mm

SD: 13 μm

ACD: 3,25 mm

SD: 8 μm

LT: 4,30 mm

SD: 13 μm

WTW: 11,8 mm

SE: 43,66 D

SD: 0,01 D

ΔK: -0,50 D @ 34°

TSE: 43,68 D

SD: 0,00 D

ΔTK: -0,62 D @ 54°

K1: 43,41 D @ 34°

K2: 43,92 D @ 124°

TK1: 43,37 D @ 54°

TK2: 44,00 D @ 144°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+22,00

-0,76

+21,50

-0,42

+21,00

-0,09

+20,50

+0,24

+20,00

+0,57

+20,87

Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+22,00

-0,76

+21,50

-0,42

+21,00

-0,09

+20,50

+0,24

+20,00

+0,57

+20,87

Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+21,50

-0,60

+21,00

-0,26

+20,50

+0,07

+20,00

+0,40

+19,50

+0,73

+20,61

Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+21,50

-0,60

+21,00

-0,26

+20,50

+0,07

+20,00

+0,40

+19,50

+0,73

+20,61

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+21,50

-0,51

+21,00

-0,17

+20,50

+0,16

+20,00

+0,49

+19,50

+0,82

+20,74

Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+22,00

-0,71

+21,50

-0,37

+21,00

-0,04

+20,50

+0,29

+20,00

+0,62

+20,94

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+21,50

-0,69

+21,00

-0,35

+20,50

-0,01

+20,00

+0,32

+19,50

+0,65

+20,49

Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+21,50

-0,55

+21,00

-0,21

+20,50

+0,12

+20,00

+0,45

+19,50

+0,77

+20,68

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700

Versión 1.88.1.64861

Fue impreso el 03-07-2024 12:05 por Administrator.

Página 2 de 4

Paciente

ROHART BROWN MARIA ANGELICA


Fecha de nacim. 21-11-1945
ID del paciente 5313507-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

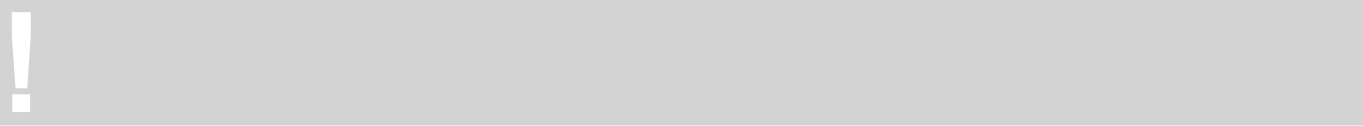

OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	LVC: No tratado
Valores biométricos			
AL: 23,61 mm	SD: 9 µm	WTW: 11,9 mm	lx: +0,6 mm ly: +0,2 mm
CCT: 584 µm	SD: 3 µm	P: 3,6 mm	CW-Chord: 0,5 mm @ 194°
ACD: 3,21 mm	SD: 6 µm		
LT: 4,35 mm	SD: 9 µm		
SE: 43,79 D	SD: 0,01 D	TSE: 43,87 D	SD: 0,01 D
K1: 43,55 D @ 145°	SD: 0,02 D	TK1: 43,58 D @ 132°	SD: 0,04 D
K2: 44,04 D @ 55°	SD: 0,01 D	TK2: 44,17 D @ 42°	SD: 0,04 D
ΔK: -0,49 D @ 145°		ΔTK: -0,59 D @ 132°	
Scan B			
Queratometría	Blanco a blanco	Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma
------------	-------



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente


ROHART BROWN MARIA ANGELICA

Fecha de nacim. 21-11-1945
ID del paciente 5313507-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024de: Administrator
n: 1,3375Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Análisis

OS
izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---VS: Humor vítreo
VA: ---


LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 23,74 mm	SD: 13 µm	WTW: 11,8 mm	Ix: -0,4 mm	Iy: +0,3 mm
CCT: 587 µm	SD: 4 µm	P: 3,8 mm	CW-Chord: 0,3 mm @ 323°	
ACD: 3,25 mm	SD: 8 µm			
LT: 4,30 mm	SD: 13 µm			

SE: 43,66 D	SD: 0,01 D	TSE: 43,68 D	SD: 0,00 D
K1: 43,41 D @ 34°	SD: 0,01 D	TK1: 43,37 D @ 54°	SD: 0,03 D
K2: 43,92 D @ 124°	SD: 0,01 D	TK2: 44,00 D @ 144°	SD: 0,03 D
ΔK: -0,50 D @ 34°		ΔTK: -0,62 D @ 54°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

