

Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 21,11 mm SD: 11 µm
ACD: 2,21 mm SD: 4 µm
LT: 4,41 mm SD: 8 µm
WTW: 11,2 mm
SE: 45,44 D SD: 0,01 D K1: 44,63 D @ 164°
ΔK: -1,65 D @ 164° K2: 46,28 D @ 74°
TSE: 45,18 D SD: 0,00 D TK1: 44,58 D @ 160°
ΔTK: -1,23 D @ 160° TK2: 45,81 D @ 70°

AL: 21,12 mm SD: 7 µm
ACD: 2,17 mm SD: 4 µm
LT: 4,60 mm SD: 9 µm
WTW: 11,4 mm
SE: 45,33 D SD: 0,02 D K1: 44,31 D @ 10°
ΔK: -2,10 D @ 10° K2: 46,41 D @ 100°
TSE: 45,06 D SD: 0,03 D TK1: 44,25 D @ 12°
ΔTK: -1,66 D @ 12° TK2: 45,91 D @ 102°

K

Alcon SN60WF

- SRK@/T -
Const. A: 119,00
IOL (D) Ref (D)
+28,50 -0,63
+28,00 -0,28
+27,50 +0,07
+27,00 +0,42
+26,50 +0,76
+27,60 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK@/T -
Const. A: 118,80
IOL (D) Ref (D)
+28,50 -0,89
+28,00 -0,53
+27,50 -0,17
+27,00 +0,18
+26,50 +0,53
+27,26 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK@/T -
Const. A: 119,00
IOL (D) Ref (D)
+28,50 -0,57
+28,00 -0,22
+27,50 +0,13
+27,00 +0,48
+26,50 +0,82
+27,69 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK@/T -
Const. A: 118,80
IOL (D) Ref (D)
+28,50 -0,83
+28,00 -0,47
+27,50 -0,11
+27,00 +0,24
+26,50 +0,59
+27,34 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK@/T -
Const. A: 119,20
IOL (D) Ref (D)
+29,00 -0,73
+28,50 -0,38
+28,00 -0,03
+27,50 +0,31
+27,00 +0,65
+27,96 Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK@/T -
Const. A: 119,13
IOL (D) Ref (D)
+29,00 -0,82
+28,50 -0,47
+28,00 -0,12
+27,50 +0,23
+27,00 +0,57
+27,83 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK@/T -
Const. A: 119,20
IOL (D) Ref (D)
+29,00 -0,67
+28,50 -0,32
+28,00 +0,03
+27,50 +0,37
+27,00 +0,71
+28,04 Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK@/T -
Const. A: 119,13
IOL (D) Ref (D)
+29,00 -0,76
+28,50 -0,41
+28,00 -0,06
+27,50 +0,29
+27,00 +0,63
+27,92 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 02-07-2024 16:07 por Administrator. Página 1 de 5

Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD derecho				Cálculo de IOL				OS izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°				LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 21,11 mm SD: 11 µm ACD: 2,21 mm SD: 4 µm LT: 4,41 mm SD: 8 µm WTW: 11,2 mm								AL: 21,12 mm SD: 7 µm ACD: 2,17 mm SD: 4 µm LT: 4,60 mm SD: 9 µm WTW: 11,4 mm							
SE: 45,44 D SD: 0,01 D K1: 44,63 D @ 164° ΔK: -1,65 D @ 164° K2: 46,28 D @ 74° TSE: 45,18 D SD: 0,00 D TK1: 44,58 D @ 160° ΔTK: -1,23 D @ 160° TK2: 45,81 D @ 70°								SE: 45,33 D SD: 0,02 D K1: 44,31 D @ 10° ΔK: -2,10 D @ 10° K2: 46,41 D @ 100° TSE: 45,06 D SD: 0,03 D TK1: 44,25 D @ 12° ΔTK: -1,66 D @ 12° TK2: 45,91 D @ 102°							
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K Alcon Toric SN6ATX(2-9)		K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K Alcon Toric SN6ATX(2-9)		K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K Alcon Toric SN6ATX(2-9)		K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K Alcon Toric SN6ATX(2-9)	
- SRK@/T - Const. A: 119,20 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,73 +28,50 -0,38 +28,00 -0,03 +27,50 +0,31 +27,00 +0,65 +27,96 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,20 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,73 +28,50 -0,38 +28,00 -0,03 +27,50 +0,31 +27,00 +0,65 +27,96 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,20 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,67 +28,50 -0,32 +28,00 +0,03 +27,50 +0,37 +27,00 +0,71 +28,04 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,20 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,67 +28,50 -0,32 +28,00 +0,03 +27,50 +0,37 +27,00 +0,71 +28,04 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,20 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,67 +28,50 -0,32 +28,00 +0,03 +27,50 +0,37 +27,00 +0,71 +28,04 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,20 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,67 +28,50 -0,32 +28,00 +0,03 +27,50 +0,37 +27,00 +0,71 +28,04 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,20 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,67 +28,50 -0,32 +28,00 +0,03 +27,50 +0,37 +27,00 +0,71 +28,04 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,20 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,67 +28,50 -0,32 +28,00 +0,03 +27,50 +0,37 +27,00 +0,71 +28,04 Emetropía	
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K JNJ ICB00 EYHANCE		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K JNJ ICB00 EYHANCE		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K JNJ ICB00 EYHANCE		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K JNJ ICB00 EYHANCE	
- SRK@/T - Const. A: 119,10 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,86 +28,50 -0,51 +28,00 -0,15 +27,50 +0,19 +27,00 +0,54 +27,78 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,26 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,65 +28,50 -0,30 +28,00 +0,04 +27,50 +0,38 +27,00 +0,72 +28,06 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,10 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,80 +28,50 -0,45 +28,00 -0,10 +27,50 +0,25 +27,00 +0,59 +27,86 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,10 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,80 +28,50 -0,45 +28,00 -0,10 +27,50 +0,25 +27,00 +0,59 +27,86 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,26 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,59 +28,50 -0,24 +28,00 +0,10 +27,50 +0,44 +27,00 +0,78 +28,15 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,26 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,59 +28,50 -0,24 +28,00 +0,10 +27,50 +0,44 +27,00 +0,78 +28,15 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,26 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,59 +28,50 -0,24 +28,00 +0,10 +27,50 +0,44 +27,00 +0,78 +28,15 Emetropía		- SRK@/T - Const. A: 119,26 IOL (D) Ref (D) +29,00 -0,59 +28,50 -0,24 +28,00 +0,10 +27,50 +0,44 +27,00 +0,78 +28,15 Emetropía	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.11 mm. - Nota: Ojo corto.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 21,11 mm SD: 11 µm WTW: 11,2 mm lx: +0,7 mm ly: +0,3 mm
CCT: 589 µm SD: 3 µm P: 3,5 mm CW-Chord: 0,7 mm @ 206°
ACD: 2,21 mm SD: 4 µm
LT: 4,41 mm SD: 8 µm

SE: 45,44 D	SD: 0,01 D	TSE: 45,18 D	SD: 0,00 D
K1: 44,63 D @ 164°	SD: 0,04 D	TK1: 44,58 D @ 160°	SD: 0,02 D
K2: 46,28 D @ 74°	SD: 0,03 D	TK2: 45,81 D @ 70°	SD: 0,01 D
ΔK: -1,65 D @ 164°		ΔTK: -1,23 D @ 160°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

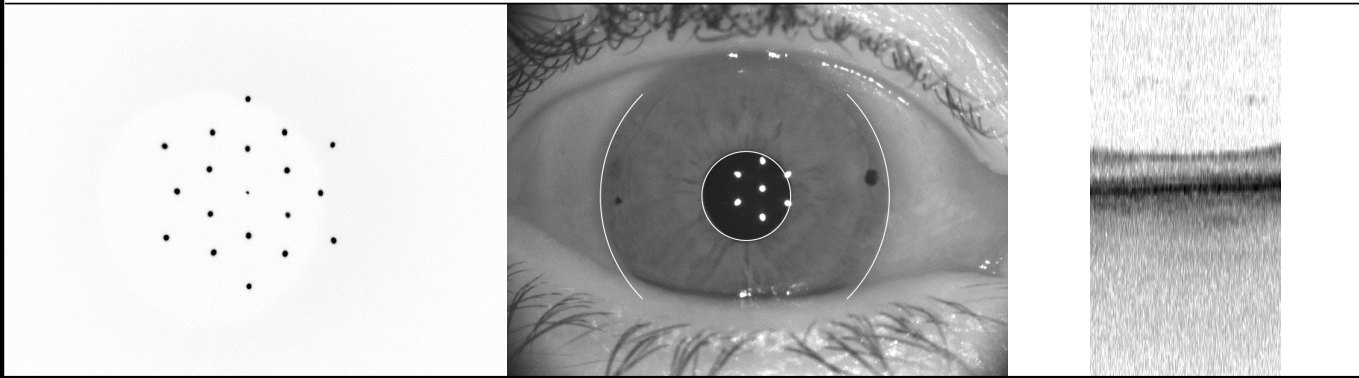

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.12 mm. - Nota: Ojo corto.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 21,12 mm SD: 7 µm WTW: 11,4 mm lx: -0,6 mm ly: +0,5 mm
CCT: 563 µm SD: 3 µm P: 3,7 mm CW-Chord: 0,5 mm @ 324°
ACD: 2,17 mm SD: 4 µm
LT: 4,60 mm SD: 9 µm

SE: 45,33 D	SD: 0,02 D	TSE: 45,06 D	SD: 0,03 D
K1: 44,31 D @ 10°	SD: 0,03 D	TK1: 44,25 D @ 12°	SD: 0,08 D
K2: 46,41 D @ 100°	SD: 0,05 D	TK2: 45,91 D @ 102°	SD: 0,05 D
ΔK: -2,10 D @ 10°		ΔTK: -1,66 D @ 12°	


Scan B

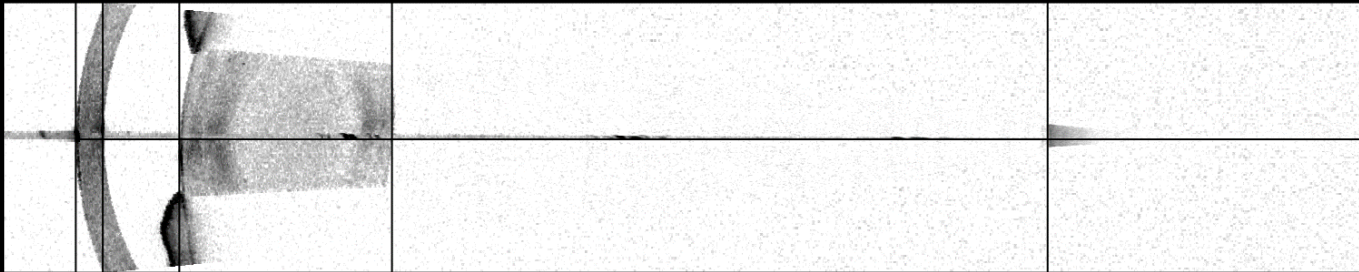

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

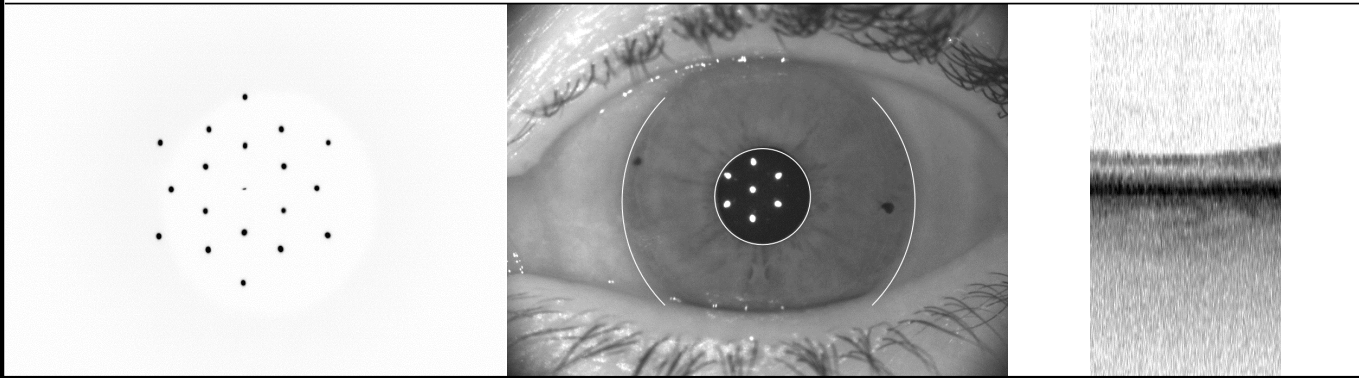

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon

Operador

Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Advertencias acerca de cálculos de IOL

SRK®/T

[OD]

SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

[OS]

SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

Advertencias relativas a mediciones

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.11 mm. - Nota: Ojo corto.

[OS]

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.12 mm. - Nota: Ojo corto.

Firma

