

Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948 Sexo Femenino
ID del paciente 6362770-4

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.11 mm. - Nota: Ojo corto.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.12 mm. - Nota: Ojo corto.

OD

derecho

Cálculo de IOL

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 21,11 mm

ACD: 2,21 mm

LT: 4,41 mm

WTW: 11,2 mm

SE: 45,44 D

ΔK: -1,65 D @ 164°

TSE: 45,18 D

ΔTK: -1,23 D @ 160°

SD: 11 μm

SD: 4 μm

SD: 8 μm

SD: 0,01 D

SD: 0,00 D

K1: 44,63 D @ 164°

K2: 46,28 D @ 74°

TK1: 44,58 D @ 160°

TK2: 45,81 D @ 70°

AL: 21,12 mm

ACD: 2,17 mm

LT: 4,60 mm

WTW: 11,4 mm

SE: 45,33 D

ΔK: -2,10 D @ 10°

TSE: 45,06 D

ΔTK: -1,66 D @ 12°

SD: 7 μm

SD: 4 μm

SD: 9 μm

SD: 0,02 D

SD: 0,03 D

K1: 44,31 D @ 10°

K2: 46,41 D @ 100°

TK1: 44,25 D @ 12°

TK2: 45,91 D @ 102°

K

Alcon SN60WF

- Barrett Universal II -

LF: +1,88 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+28,50 -0,80

+28,00 -0,42

+27,50 -0,05

+27,00 +0,32

+26,50 +0,68

+27,43 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Barrett Universal II -

LF: +1,64 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+28,00 -0,92

+27,50 -0,53

+27,00 -0,15

+26,50 +0,23

+26,00 +0,60

+26,80 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Barrett Universal II -

LF: +1,88 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+28,50 -0,67

+28,00 -0,30

+27,50 +0,07

+27,00 +0,44

+26,50 +0,81

+27,60 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Barrett Universal II -

LF: +1,64 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+28,00 -0,79

+27,50 -0,40

+27,00 -0,02

+26,50 +0,35

+26,00 +0,72

+26,97 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+29,00 -0,89

+28,50 -0,51

+28,00 -0,14

+27,50 +0,23

+27,00 +0,59

+27,81 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+29,00 -0,89

+28,50 -0,51

+28,00 -0,14

+27,50 +0,23

+27,00 +0,59

+27,81 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+29,00 -0,76

+28,50 -0,38

+28,00 -0,01

+27,50 +0,35

+27,00 +0,71

+27,98 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+29,00 -0,76

+28,50 -0,38

+28,00 -0,01

+27,50 +0,35

+27,00 +0,71

+27,98 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948 Sexo Femenino
ID del paciente 6362770-4

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.11 mm. - Nota: Ojo corto.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.12 mm. - Nota: Ojo corto.

OD derecho				Cálculo de IOL				OS izquierdo							
															
Estatus del ojo															
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°				LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 21,11 mm ACD: 2,21 mm LT: 4,41 mm WTW: 11,2 mm				SD: 11 µm SD: 4 µm SD: 8 µm				AL: 21,12 mm ACD: 2,17 mm LT: 4,60 mm WTW: 11,4 mm				SD: 7 µm SD: 4 µm SD: 9 µm			
SE: 45,44 D ΔK: -1,65 D @164° TSE: 45,18 D ΔTK: -1,23 D @160°				SD: 0,01 D K1: 44,63 D @164° K2: 46,28 D @ 74° TK1: 44,58 D @160° TK2: 45,81 D @ 70°				SE: 45,33 D ΔK: -2,10 D @ 10° TSE: 45,06 D ΔTK: -1,66 D @ 12°				SD: 0,02 D K1: 44,31 D @ 10° K2: 46,41 D @100° TK1: 44,25 D @ 12° TK2: 45,91 D @102°			
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0		K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0		K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0		K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0	
- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar	
IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)	
+28,50 -0,58		+28,50 -0,68		+29,00 -0,83		+28,50 -0,68		+29,00 -0,83		+28,50 -0,93		+29,00 -0,83		+28,50 -0,93	
+28,00 -0,20		+28,00 -0,30		+28,50 -0,45		+28,00 -0,30		+28,50 -0,45		+28,50 -0,55		+28,00 -0,18		+28,50 -0,55	
+27,50 +0,16		+27,50 +0,07		+28,00 -0,08		+27,50 +0,44		+28,00 -0,08		+27,50 +0,19		+28,00 -0,18		+27,50 +0,19	
+27,00 +0,53		+27,00 +0,44		+27,50 +0,29		+26,50 +0,80		+27,50 +0,29		+27,00 +0,56		+27,50 +0,19		+27,00 +0,56	
+26,50 +0,89		+26,50 +0,80		+27,00 +0,65		+27,60 Emetropía		+27,00 +0,65		+27,00 +0,56		+27,00 +0,56		+27,00 +0,56	
+27,73 Emetropía		+27,60 Emetropía		+27,89 Emetropía				+27,89 Emetropía		+27,76 Emetropía		+27,76 Emetropía		+27,76 Emetropía	
K Alcon AcrySof MA60AC		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K Alcon AcrySof MA60AC		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K Alcon AcrySof MA60AC		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K Alcon AcrySof MA60AC		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)	
- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar	
IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)	
+28,50 -0,57		+28,50 -0,68		+29,00 -0,82		+28,50 -0,68		+29,00 -0,82		+28,50 -0,93		+29,00 -0,82		+28,50 -0,93	
+28,00 -0,20		+28,00 -0,30		+28,50 -0,45		+28,00 -0,30		+28,50 -0,45		+28,50 -0,55		+28,00 -0,18		+28,50 -0,55	
+27,50 +0,17		+27,50 +0,07		+28,00 -0,08		+27,00 +0,44		+28,00 -0,08		+27,50 +0,19		+28,00 -0,18		+27,50 +0,19	
+27,00 +0,53		+27,00 +0,44		+27,50 +0,29		+26,50 +0,80		+27,50 +0,29		+27,00 +0,56		+27,50 +0,19		+27,00 +0,56	
+26,50 +0,89		+26,50 +0,80		+27,00 +0,65		+27,60 Emetropía		+27,00 +0,65		+27,00 +0,56		+27,00 +0,56		+27,00 +0,56	
+27,73 Emetropía		+27,60 Emetropía		+27,90 Emetropía				+27,90 Emetropía		+27,76 Emetropía		+27,76 Emetropía		+27,76 Emetropía	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 21.11 mm. - Nota: Ojo corto.

OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: --- LVC: No tratado	
Valores biométricos			
AL: 21,11 mm CCT: 589 µm ACD: 2,21 mm LT: 4,41 mm		SD: 11 µm SD: 3 µm SD: 4 µm SD: 8 µm WTW: 11,2 mm P: 3,5 mm Ix: +0,7 mm ly: +0,3 mm CW-Chord: 0,7 mm @ 206°	
SE: 45,44 D K1: 44,63 D @ 164° K2: 46,28 D @ 74° ΔK: -1,65 D @ 164°		SD: 0,01 D SD: 0,04 D SD: 0,03 D TSE: 45,18 D TK1: 44,58 D @ 160° TK2: 45,81 D @ 70° ΔTK: -1,23 D @ 160° SD: 0,00 D SD: 0,02 D SD: 0,01 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.12 mm. - Nota: Ojo corto.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 21,12 mm SD: 7 µm WTW: 11,4 mm lx: -0,6 mm ly: +0,5 mm
CCT: 563 µm SD: 3 µm P: 3,7 mm CW-Chord: 0,5 mm @ 324°
ACD: 2,17 mm SD: 4 µm
LT: 4,60 mm SD: 9 µm

SE: 45,33 D	SD: 0,02 D	TSE: 45,06 D	SD: 0,03 D
K1: 44,31 D @ 10°	SD: 0,03 D	TK1: 44,25 D @ 12°	SD: 0,08 D
K2: 46,41 D @ 100°	SD: 0,05 D	TK2: 45,91 D @ 102°	SD: 0,05 D
ΔK: -2,10 D @ 10°		ΔTK: -1,66 D @ 12°	


Scan B

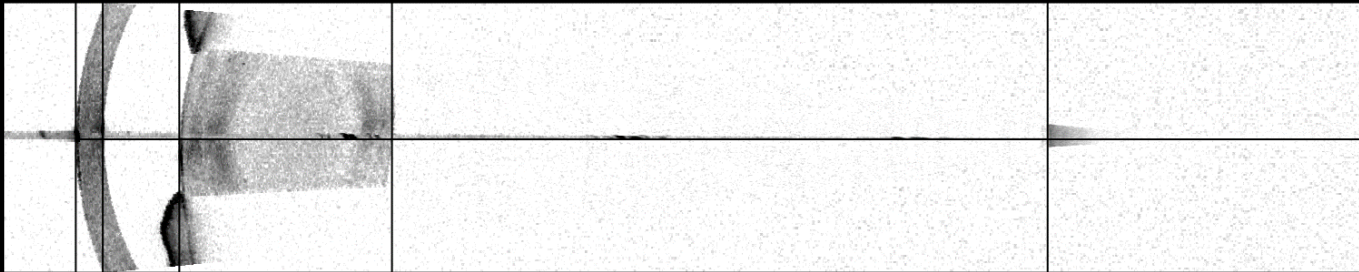

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

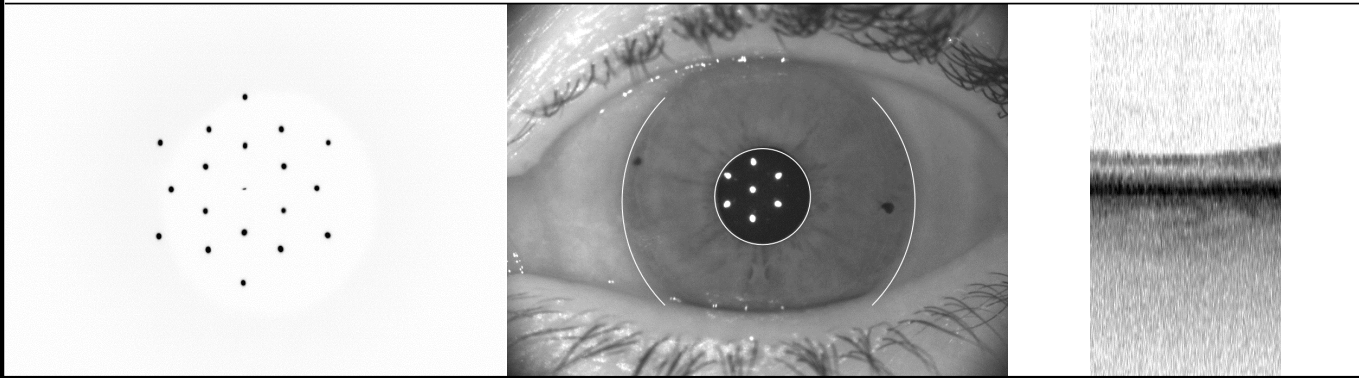

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

