

Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 21,11 mm

SD: 11 µm

ACD: 2,21 mm

SD: 4 µm

LT: 4,41 mm

SD: 8 µm

WTW: 11,2 mm

SE: 45,44 D

SD: 0,01 D

K1: 44,63 D @ 164°

ΔK: -1,65 D @ 164°

TSE: 45,18 D

SD: 0,00 D

TK1: 44,58 D @ 160°

ΔTK: -1,23 D @ 160°

AL: 21,12 mm

SD: 7 µm

ACD: 2,17 mm

SD: 4 µm

LT: 4,60 mm

SD: 9 µm

WTW: 11,4 mm

SE: 45,33 D

SD: 0,02 D

K1: 44,31 D @ 10°

ΔK: -2,10 D @ 10°

TSE: 45,06 D

SD: 0,03 D

TK1: 44,25 D @ 12°

ΔTK: -1,66 D @ 12°

K

Alcon SN60WF

- Hoffer® Q -

pACD: +5,64

IOL (D) Ref (D)

+29,50 -0,81

+29,00 -0,46

+28,50 -0,12

+28,00 +0,23

+27,50 +0,57

+28,33 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Hoffer® Q -

pACD: +5,44

IOL (D) Ref (D)

+29,00 -0,88

+28,50 -0,52

+28,00 -0,17

+27,50 +0,18

+27,00 +0,52

+27,76 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Hoffer® Q -

pACD: +5,64

IOL (D) Ref (D)

+29,50 -0,74

+29,00 -0,39

+28,50 -0,04

+28,00 +0,30

+27,50 +0,64

+28,44 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Hoffer® Q -

pACD: +5,44

IOL (D) Ref (D)

+29,00 -0,80

+28,50 -0,45

+28,00 -0,10

+27,50 +0,25

+27,00 +0,60

+27,86 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Hoffer® Q -

pACD: +5,67

IOL (D) Ref (D)

+29,50 -0,75

+29,00 -0,40

+28,50 -0,05

+28,00 +0,29

+27,50 +0,62

+28,42 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Hoffer® Q -

pACD: +5,77

IOL (D) Ref (D)

+29,50 -0,54

+29,00 -0,19

+28,50 +0,15

+28,00 +0,48

+27,50 +0,81

+28,72 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Hoffer® Q -

pACD: +5,67

IOL (D) Ref (D)

+29,50 -0,67

+29,00 -0,32

+28,50 +0,02

+28,00 +0,36

+27,50 +0,70

+28,53 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Hoffer® Q -

pACD: +5,77

IOL (D) Ref (D)

+30,00 -0,81

+29,50 -0,46

+29,00 -0,12

+28,50 +0,22

+28,00 +0,56

+28,83 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 02-07-2024 16:09 por Administrator. Página 1 de 5

Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 21,11 mm				SD: 11 µm				AL: 21,12 mm				SD: 7 µm			
ACD: 2,21 mm				SD: 4 µm				ACD: 2,17 mm				SD: 4 µm			
LT: 4,41 mm				SD: 8 µm				LT: 4,60 mm				SD: 9 µm			
WTW: 11,2 mm								WTW: 11,4 mm							
SE: 45,44 D				SD: 0,01 D				SE: 45,33 D				SD: 0,02 D			
ΔK: -1,65 D @164°				K1: 44,63 D @ 164°				SE: 45,33 D				SD: 0,02 D			
				K2: 46,28 D @ 74°				ΔK: -2,10 D @ 10°				K1: 44,31 D @ 10°			
TSE: 45,18 D				TK1: 44,58 D @ 160°				TSE: 45,06 D				SD: 0,03 D			
ΔTK: -1,23 D @ 160°				TK2: 45,81 D @ 70°				ΔTK: -1,66 D @ 12°				TK1: 44,25 D @ 12°			
								TK2: 45,91 D @ 102°							
K Alcon Panoptix TFNT00				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon Panoptix TFNT00				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)			
- Hoffer® Q -				- Hoffer® Q -				- Hoffer® Q -				- Hoffer® Q -			
pACD: +5,64				pACD: +5,61				pACD: +5,64				pACD: +5,61			
IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)	
+29,50		-0,81		+29,00		-0,52		+29,50		-0,74		+29,50		-0,80	
+29,00		-0,46		+28,50		-0,18		+29,00		-0,39		+29,00		-0,45	
+28,50		-0,12		+28,00		+0,17		+28,50		-0,04		+28,50		-0,10	
+28,00		+0,23		+27,50		+0,51		+28,00		+0,30		+28,00		+0,24	
+27,50		+0,57		+27,00		+0,84		+27,50		+0,64		+27,50		+0,58	
+28,33		Emetropía		+28,24		Emetropía		+28,44		Emetropía		+28,35		Emetropía	
K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY			
- Hoffer® Q -				- Hoffer® Q -				- Hoffer® Q -				- Hoffer® Q -			
pACD: +5,81				pACD: +5,67				pACD: +5,81				pACD: +5,67			
IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)	
+30,00		-0,80		+29,50		-0,75		+30,00		-0,72		+29,50		-0,67	
+29,50		-0,45		+29,00		-0,40		+29,50		-0,38		+29,00		-0,32	
+29,00		-0,11		+28,50		-0,05		+29,00		-0,04		+28,50		+0,02	
+28,50		+0,23		+28,00		+0,29		+28,50		+0,30		+28,00		+0,36	
+28,00		+0,56		+27,50		+0,62		+28,00		+0,63		+27,50		+0,70	
+28,84		Emetropía		+28,42		Emetropía		+28,95		Emetropía		+28,53		Emetropía	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.11 mm. - Nota: Ojo corto.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 21,11 mm SD: 11 µm WTW: 11,2 mm lx: +0,7 mm ly: +0,3 mm
CCT: 589 µm SD: 3 µm P: 3,5 mm CW-Chord: 0,7 mm @ 206°
ACD: 2,21 mm SD: 4 µm
LT: 4,41 mm SD: 8 µm

SE: 45,44 D	SD: 0,01 D	TSE: 45,18 D	SD: 0,00 D
K1: 44,63 D @ 164°	SD: 0,04 D	TK1: 44,58 D @ 160°	SD: 0,02 D
K2: 46,28 D @ 74°	SD: 0,03 D	TK2: 45,81 D @ 70°	SD: 0,01 D
ΔK: -1,65 D @ 164°		ΔTK: -1,23 D @ 160°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

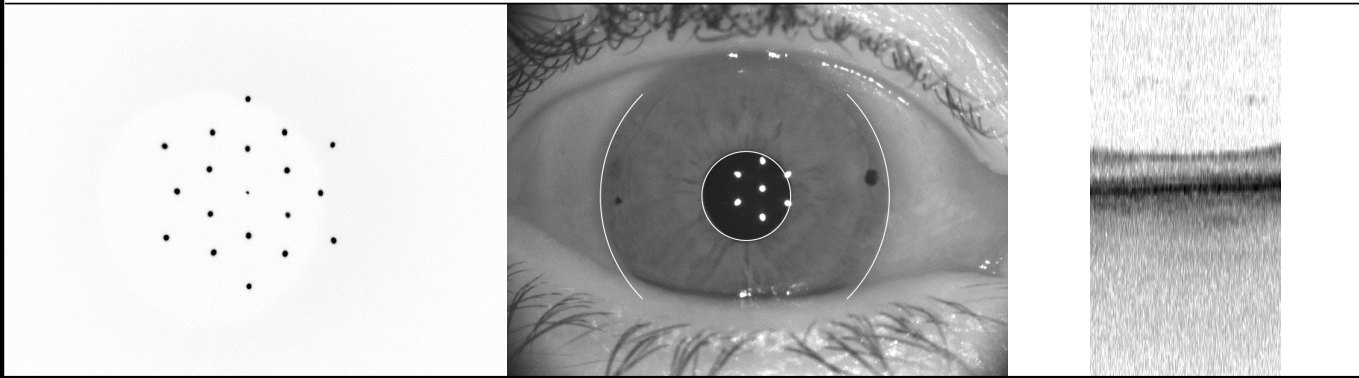

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.12 mm. - Nota: Ojo corto.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 21,12 mm SD: 7 µm WTW: 11,4 mm lx: -0,6 mm ly: +0,5 mm
CCT: 563 µm SD: 3 µm P: 3,7 mm CW-Chord: 0,5 mm @ 324°
ACD: 2,17 mm SD: 4 µm
LT: 4,60 mm SD: 9 µm

SE: 45,33 D SD: 0,02 D TSE: 45,06 D SD: 0,03 D
K1: 44,31 D @ 10° SD: 0,03 D TK1: 44,25 D @ 12° SD: 0,08 D
K2: 46,41 D @ 100° SD: 0,05 D TK2: 45,91 D @ 102° SD: 0,05 D
ΔK: -2,10 D @ 10° ΔTK: -1,66 D @ 12°


Scan B

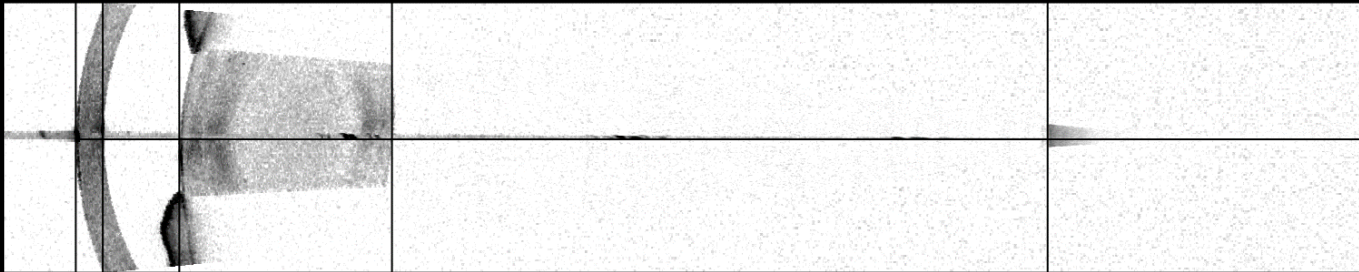

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

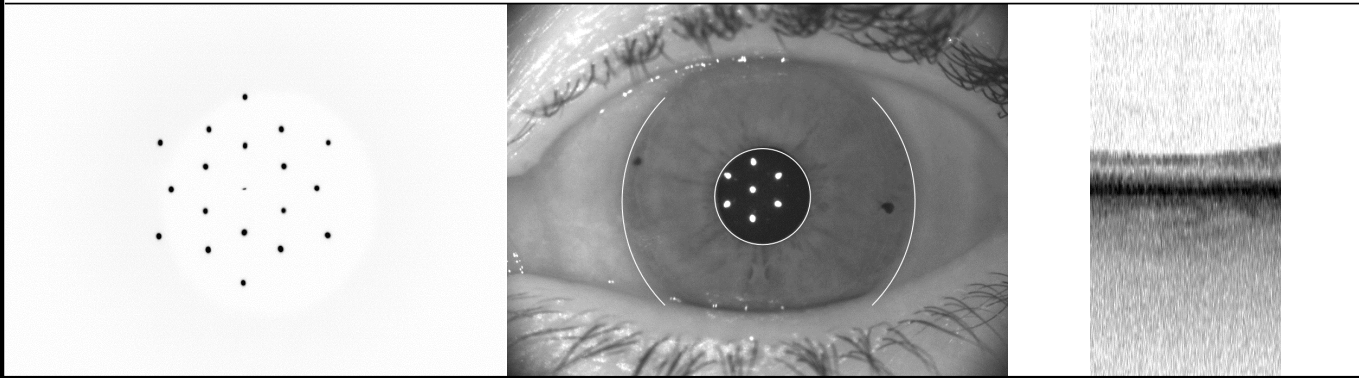

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

MOYA RUIZ LUCIA

Fecha de nacim. 03-12-1948
ID del paciente 6362770-4

Sexo Femenino

Médico Surgeon

Operador

Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Advertencias acerca de cálculos de IOL

Hoffer® Q

[OD]

Hoffer® Q es una marca de Kenneth Hoffer.

[OS]

Hoffer® Q es una marca de Kenneth Hoffer.

Advertencias relativas a mediciones

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 21.11 mm. - Nota: Ojo corto.

[OS]

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 21.12 mm. - Nota: Ojo corto.

Firma

