

Paciente

PACHECO MARCHANT BORIS

Fecha de nacim. 24-05-1962 Sexo Femenino
ID del paciente 6507257-2

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 25,41 mm

SD: 11 μm

ACD: 3,14 mm

SD: 6 μm

LT: 4,26 mm

SD: 8 μm

WTW: 12,2 mm

SE: 43,24 D

SD: 0,01 D

K1: 41,06 D @ 6°

ΔK: -4,60 D @ 6°

TSE: 43,25 D

SD: 0,04 D

TK1: 41,19 D @ 6°

ΔTK: -4,34 D @ 6°

AL: 25,57 mm

SD: 9 μm

ACD: 3,14 mm

SD: 5 μm

LT: 4,25 mm

SD: 9 μm

WTW: 11,9 mm

SE: 43,52 D

SD: 0,01 D

K1: 41,57 D @174°

ΔK: -4,09 D @174°

TSE: 43,52 D

SD: 0,03 D

TK1: 41,71 D @173°

ΔTK: -3,79 D @173°

K

Alcon SN60WF

- SRK@/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+16,50

-0,61

+16,00

-0,28

+15,50

+0,04

+15,00

+0,37

+14,50

+0,69

+15,57

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK@/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+16,50

-0,74

+16,00

-0,40

+15,50

-0,07

+15,00

+0,26

+14,50

+0,58

+15,39

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK@/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+16,00

-0,82

+15,50

-0,49

+15,00

-0,16

+14,50

+0,16

+14,00

+0,48

+14,75

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK@/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+15,50

-0,60

+15,00

-0,27

+14,50

+0,06

+14,00

+0,38

+13,50

+0,70

+14,59

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+16,50

-0,49

+16,00

-0,16

+15,50

+0,16

+15,00

+0,48

+14,50

+0,79

+15,75

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK@/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+16,50

-0,53

+16,00

-0,21

+15,50

+0,12

+15,00

+0,44

+14,50

+0,76

+15,68

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+16,00

-0,70

+15,50

-0,37

+15,00

-0,05

+14,50

+0,27

+14,00

+0,58

+14,92

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK@/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+16,00

-0,74

+15,50

-0,41

+15,00

-0,09

+14,50

+0,23

+14,00

+0,55

+14,86

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 19:02 por Administrator. Página 1 de 5

Paciente

PACHECO MARCHANT BORIS

Fecha de nacim. 24-05-1962 Sexo Femenino
ID del paciente 6507257-2

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 25,41 mm

SD: 11 µm

ACD: 3,14 mm

SD: 6 µm

LT: 4,26 mm

SD: 8 µm

WTW: 12,2 mm

SE: 43,24 D

SD: 0,01 D

K1: 41,06 D @ 6°

ΔK: -4,60 D @ 6°

TSE: 43,25 D

SD: 0,04 D

TK1: 41,19 D @ 6°

ΔTK: -4,34 D @ 6°

AL: 25,57 mm

SD: 9 µm

ACD: 3,14 mm

SD: 5 µm

LT: 4,25 mm

SD: 9 µm

WTW: 11,9 mm

SE: 43,52 D

SD: 0,01 D

K1: 41,57 D @174°

ΔK: -4,09 D @174°

TSE: 43,52 D

SD: 0,03 D

TK1: 41,71 D @173°

ΔTK: -3,79 D @173°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+16,50

-0,49

+16,00

-0,16

+15,50

+0,16

+15,00

+0,48

+14,50

+0,79

+15,75

Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+16,50

-0,49

+16,00

-0,16

+15,50

+0,16

+15,00

+0,48

+14,50

+0,79

+15,75

Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+16,00

-0,70

+15,50

-0,37

+15,00

-0,05

+14,50

+0,27

+14,00

+0,58

+14,92

Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+16,00

-0,70

+15,50

-0,37

+15,00

-0,05

+14,50

+0,27

+14,00

+0,58

+14,92

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK@/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+16,50

-0,55

+16,00

-0,22

+15,50

+0,10

+15,00

+0,42

+14,50

+0,74

+15,66

Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK@/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+17,00

-0,78

+16,50

-0,45

+16,00

-0,13

+15,50

+0,19

+15,00

+0,51

+15,80

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK@/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+16,00

-0,76

+15,50

-0,43

+15,00

-0,10

+14,50

+0,22

+14,00

+0,53

+14,84

Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK@/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+16,00

-0,66

+15,50

-0,34

+15,00

-0,02

+14,50

+0,30

+14,00

+0,61

+14,97

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 19:02 por Administrator. Página 2 de 5

Paciente

PACHECO MARCHANT BORIS

Fecha de nacim. 24-05-1962
ID del paciente 6507257-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 25.41 mm. - Nota: Ojo largo. OD: Cilindro del ojo derecho -4.60 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 25,41 mm	SD: 11 µm	WTW: 12,2 mm	Ix: +0,5 mm	Iy: +0,1 mm
CCT: 555 µm	SD: 3 µm	P: 4,3 mm	CW-Chord: 0,2 mm @ 215°	
ACD: 3,14 mm	SD: 6 µm			
LT: 4,26 mm	SD: 8 µm			

SE: 43,24 D	SD: 0,01 D	TSE: 43,25 D	SD: 0,04 D
K1: 41,06 D @ 6°	SD: 0,01 D	TK1: 41,19 D @ 6°	SD: 0,01 D
K2: 45,66 D @ 96°	SD: 0,02 D	TK2: 45,53 D @ 96°	SD: 0,07 D
ΔK: -4,60 D @ 6°		ΔTK: -4,34 D @ 6°	


Scan B

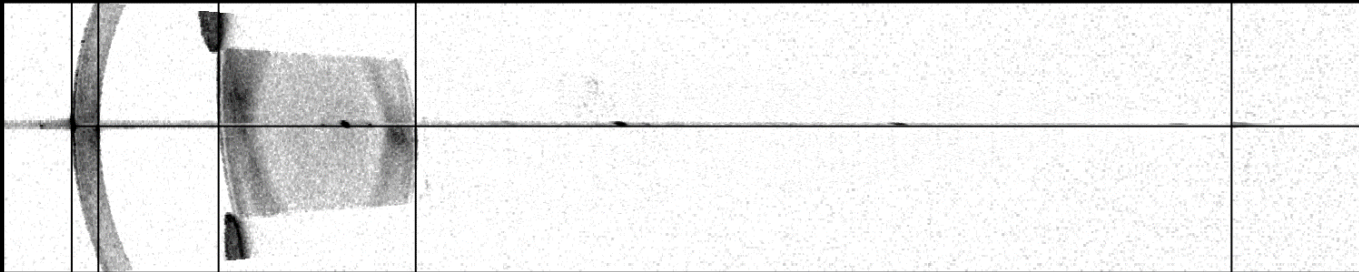

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

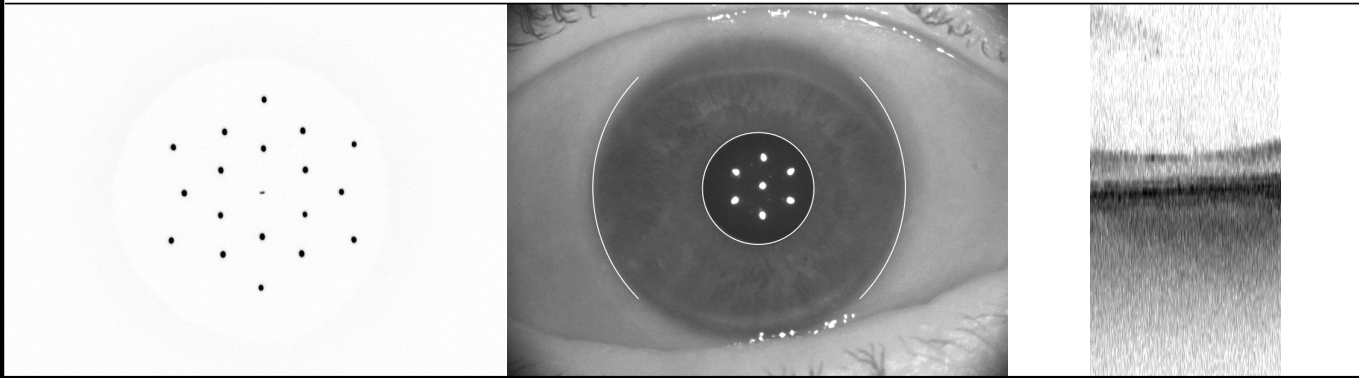

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

PACHECO MARCHANT BORIS

Fecha de nacim. 24-05-1962
ID del paciente 6507257-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.57 mm. - Nota: Ojo largo. OS: Cilindro del ojo izquierdo -4.09 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 25,57 mm SD: 9 µm WTW: 11,9 mm lx: -0,6 mm ly: +0,1 mm
CCT: 550 µm SD: 3 µm P: 3,5 mm CW-Chord: 0,4 mm @ 332°
ACD: 3,14 mm SD: 5 µm
LT: 4,25 mm SD: 9 µm

SE: 43,52 D SD: 0,01 D TSE: 43,52 D SD: 0,03 D
K1: 41,57 D @ 174° SD: 0,02 D TK1: 41,71 D @ 173° SD: 0,02 D
K2: 45,66 D @ 84° SD: 0,02 D TK2: 45,49 D @ 83° SD: 0,05 D
ΔK: -4,09 D @ 174° ΔTK: -3,79 D @ 173°


Scan B

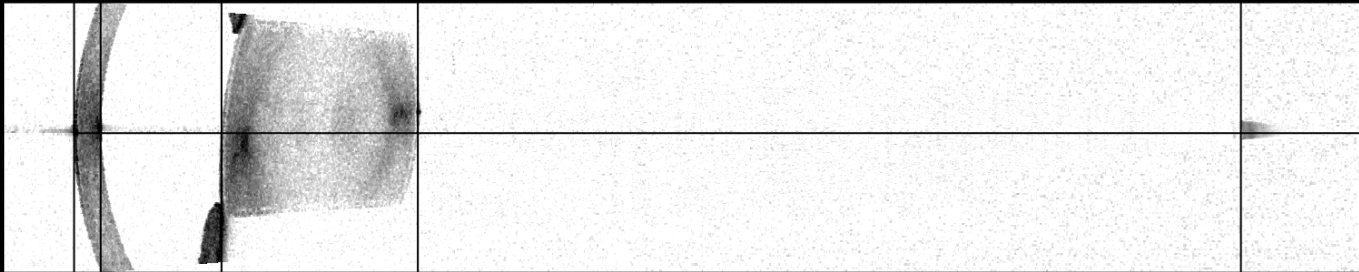

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

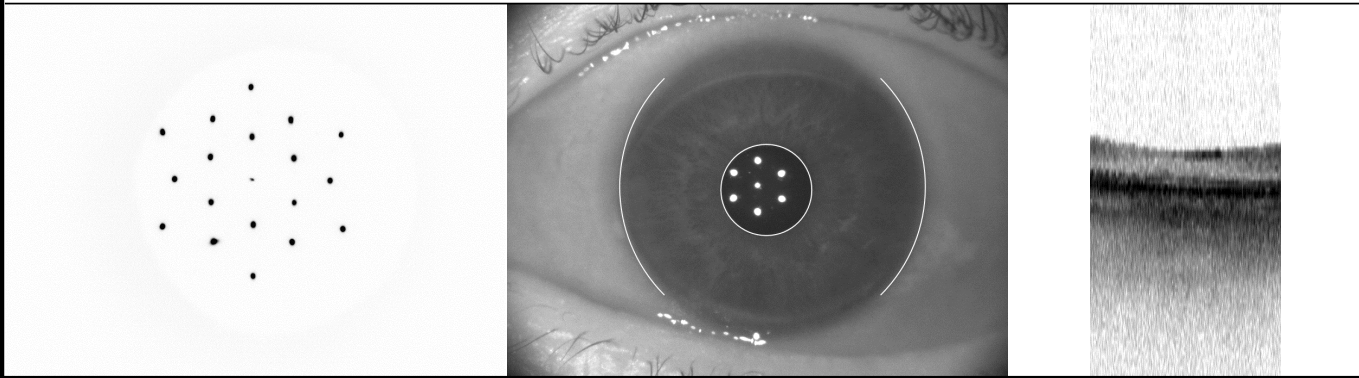

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

PACHECO MARCHANT BORIS

Fecha de nacim. 24-05-1962
ID del paciente 6507257-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon

Operador

Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Advertencias acerca de cálculos de IOL

SRK®/T

[OD]

SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

[OS]

SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

Advertencias relativas a mediciones

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

OD: Cilindro del ojo derecho -4.60 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

[OS]

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.57 mm. - Nota: Ojo largo.

OS: Cilindro del ojo izquierdo -4.09 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

Firma

